

第二回 三重県内透析施設における COVID-19対策に関するアンケート

～ 透析施設のCOVID-19対策アンケート ～

一般社団法人 共益型三重県臨床工学技士会
組織強化委員会

令和 2年 9月 7日 ～ 9月 21日



一般社団法人 共益型
三重県臨床工学技士会

目的：三重県内透析施設での現状のCOVID-19対策と、併せて
患者・医療従事者の意識調査から得られた情報を把握することで
三重県内各透析施設で更に強固な感染防止対策の一助となるよう
貢献する。

対象：三重県内透析施設 59施設

実施期間：令和 2年 9月 7日 ～ 9月 21日

回答率：52.5% (31施設)



質問 2. 外来透析患者でPCR検査を受けた患者の有無を

お答えください。

(29件 回答)

SARS-CoV-2抗原
検出検査

1
(3.4%)


いる
9
(31.0%)

いない
19
(65.5%)




質問3. 質問2で「いる」とお答えの場合、その人数を
お答えください。

(9件 回答)

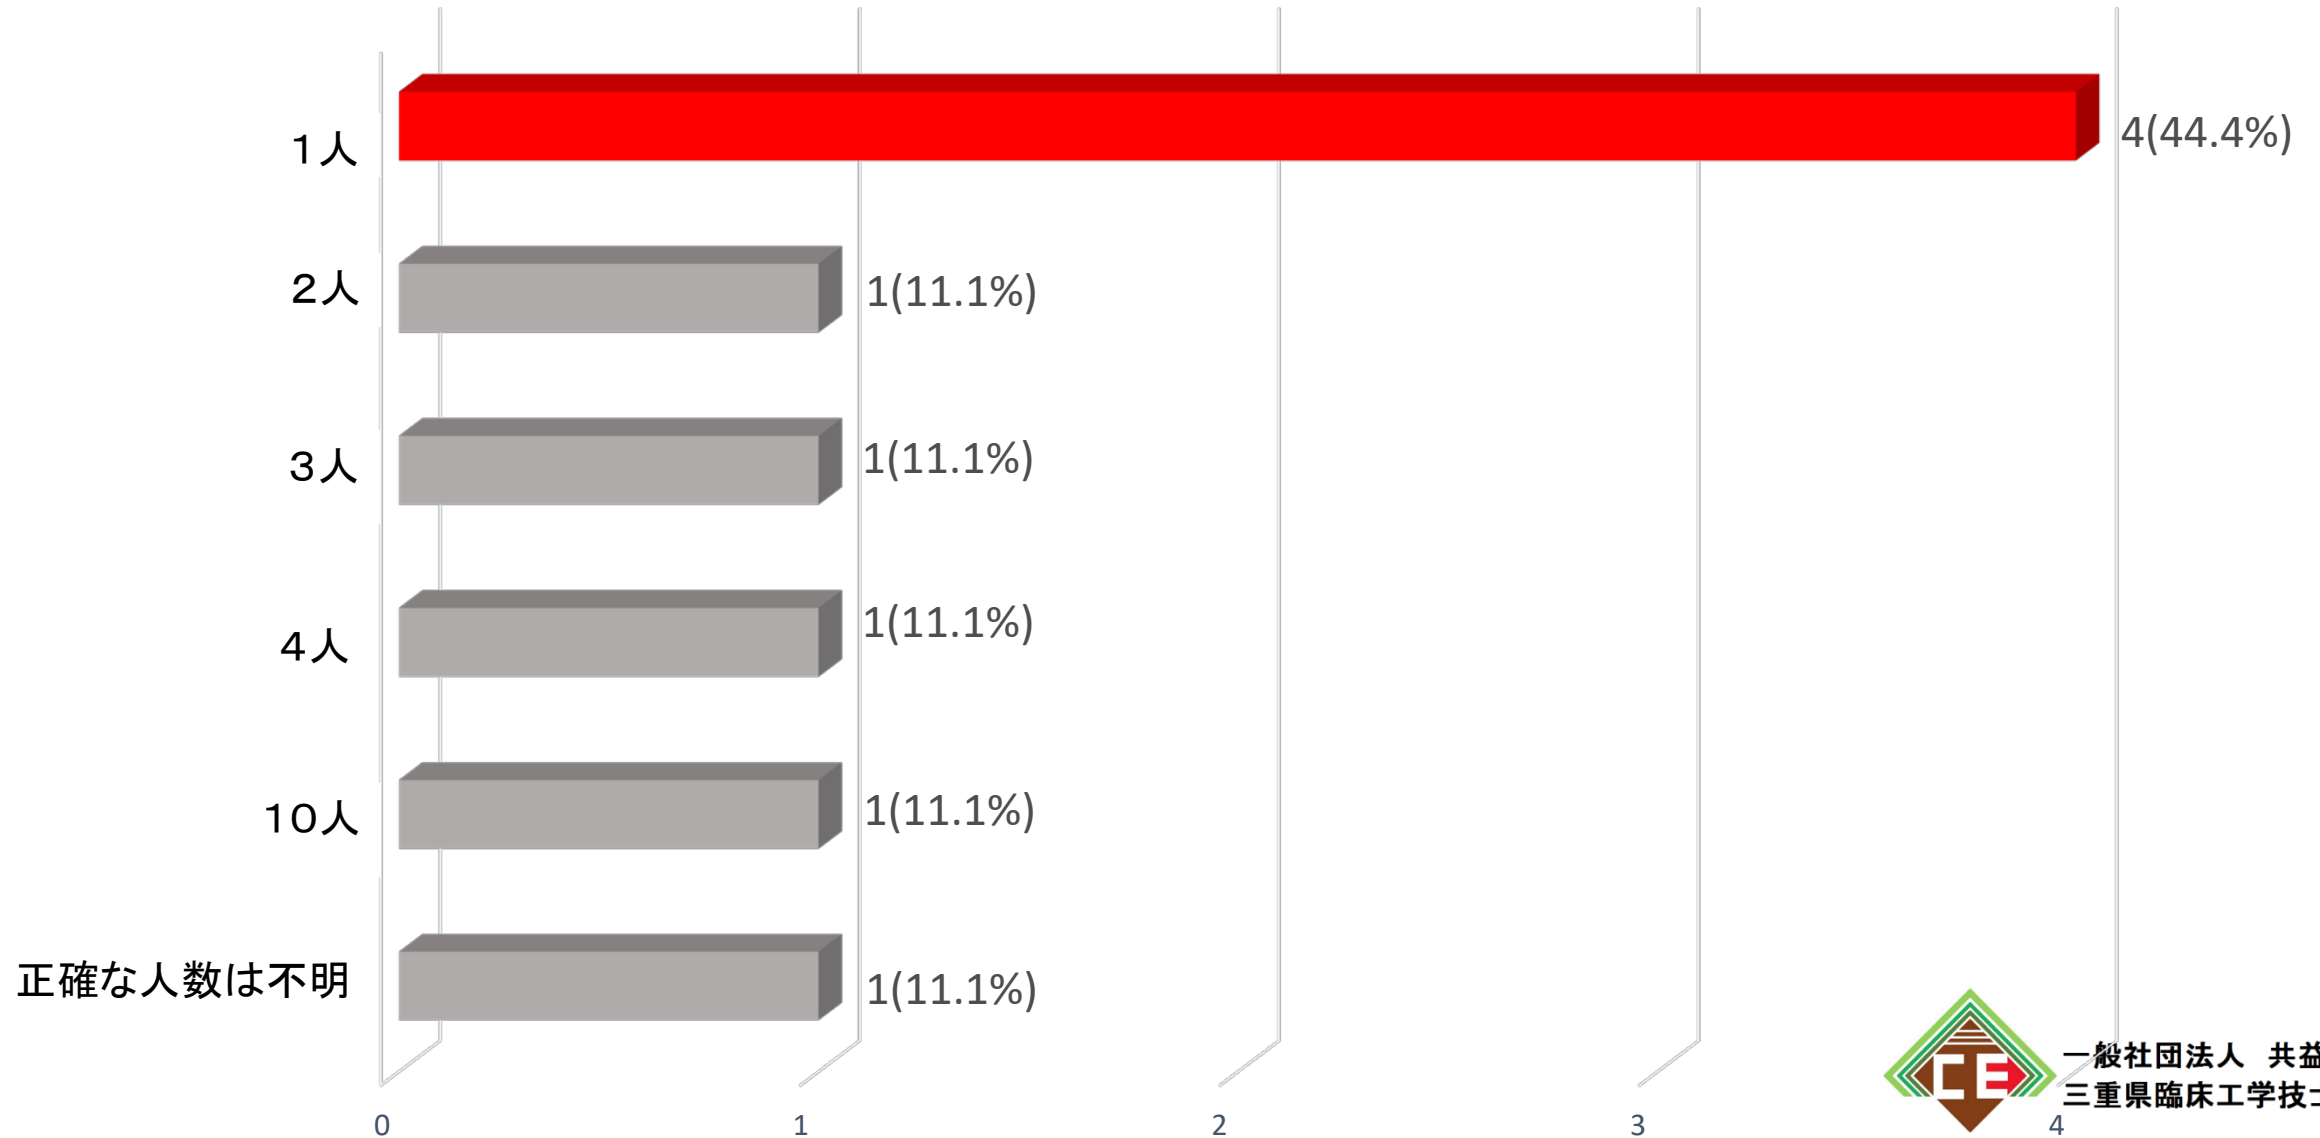


質問4. 入院透析患者でPCR検査を受けた患者の有無を
お答えください。

(25件 回答)

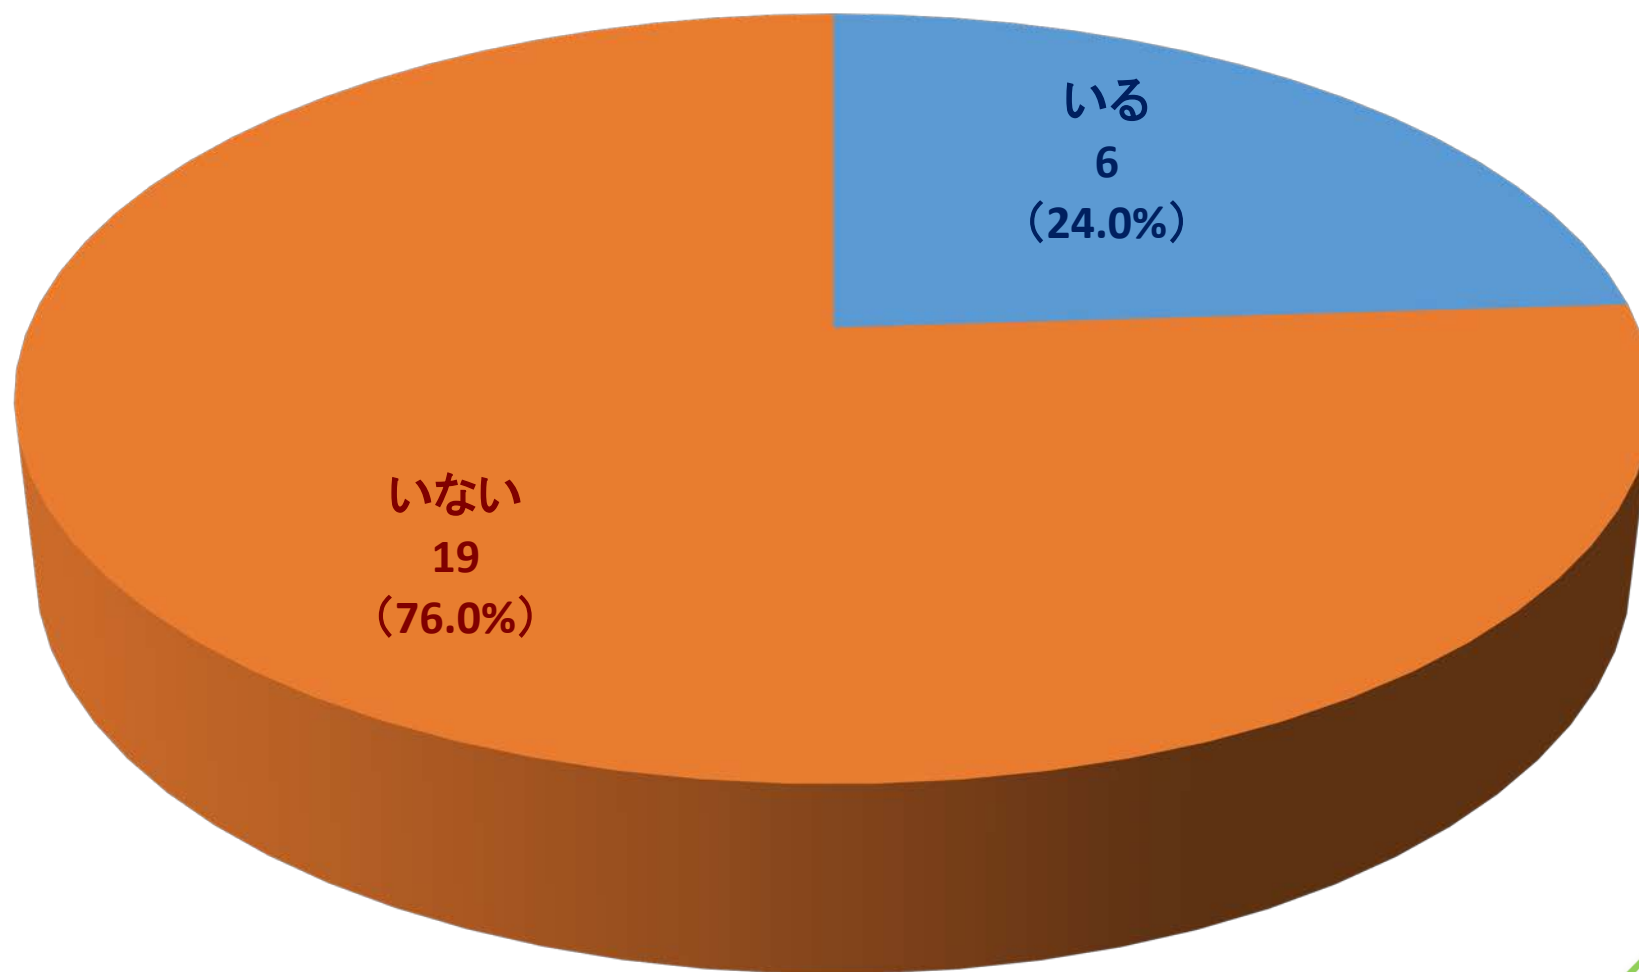


質問5. 質問4で「いる」とお答えの場合、その人数を
お答えください。

(6件 回答)

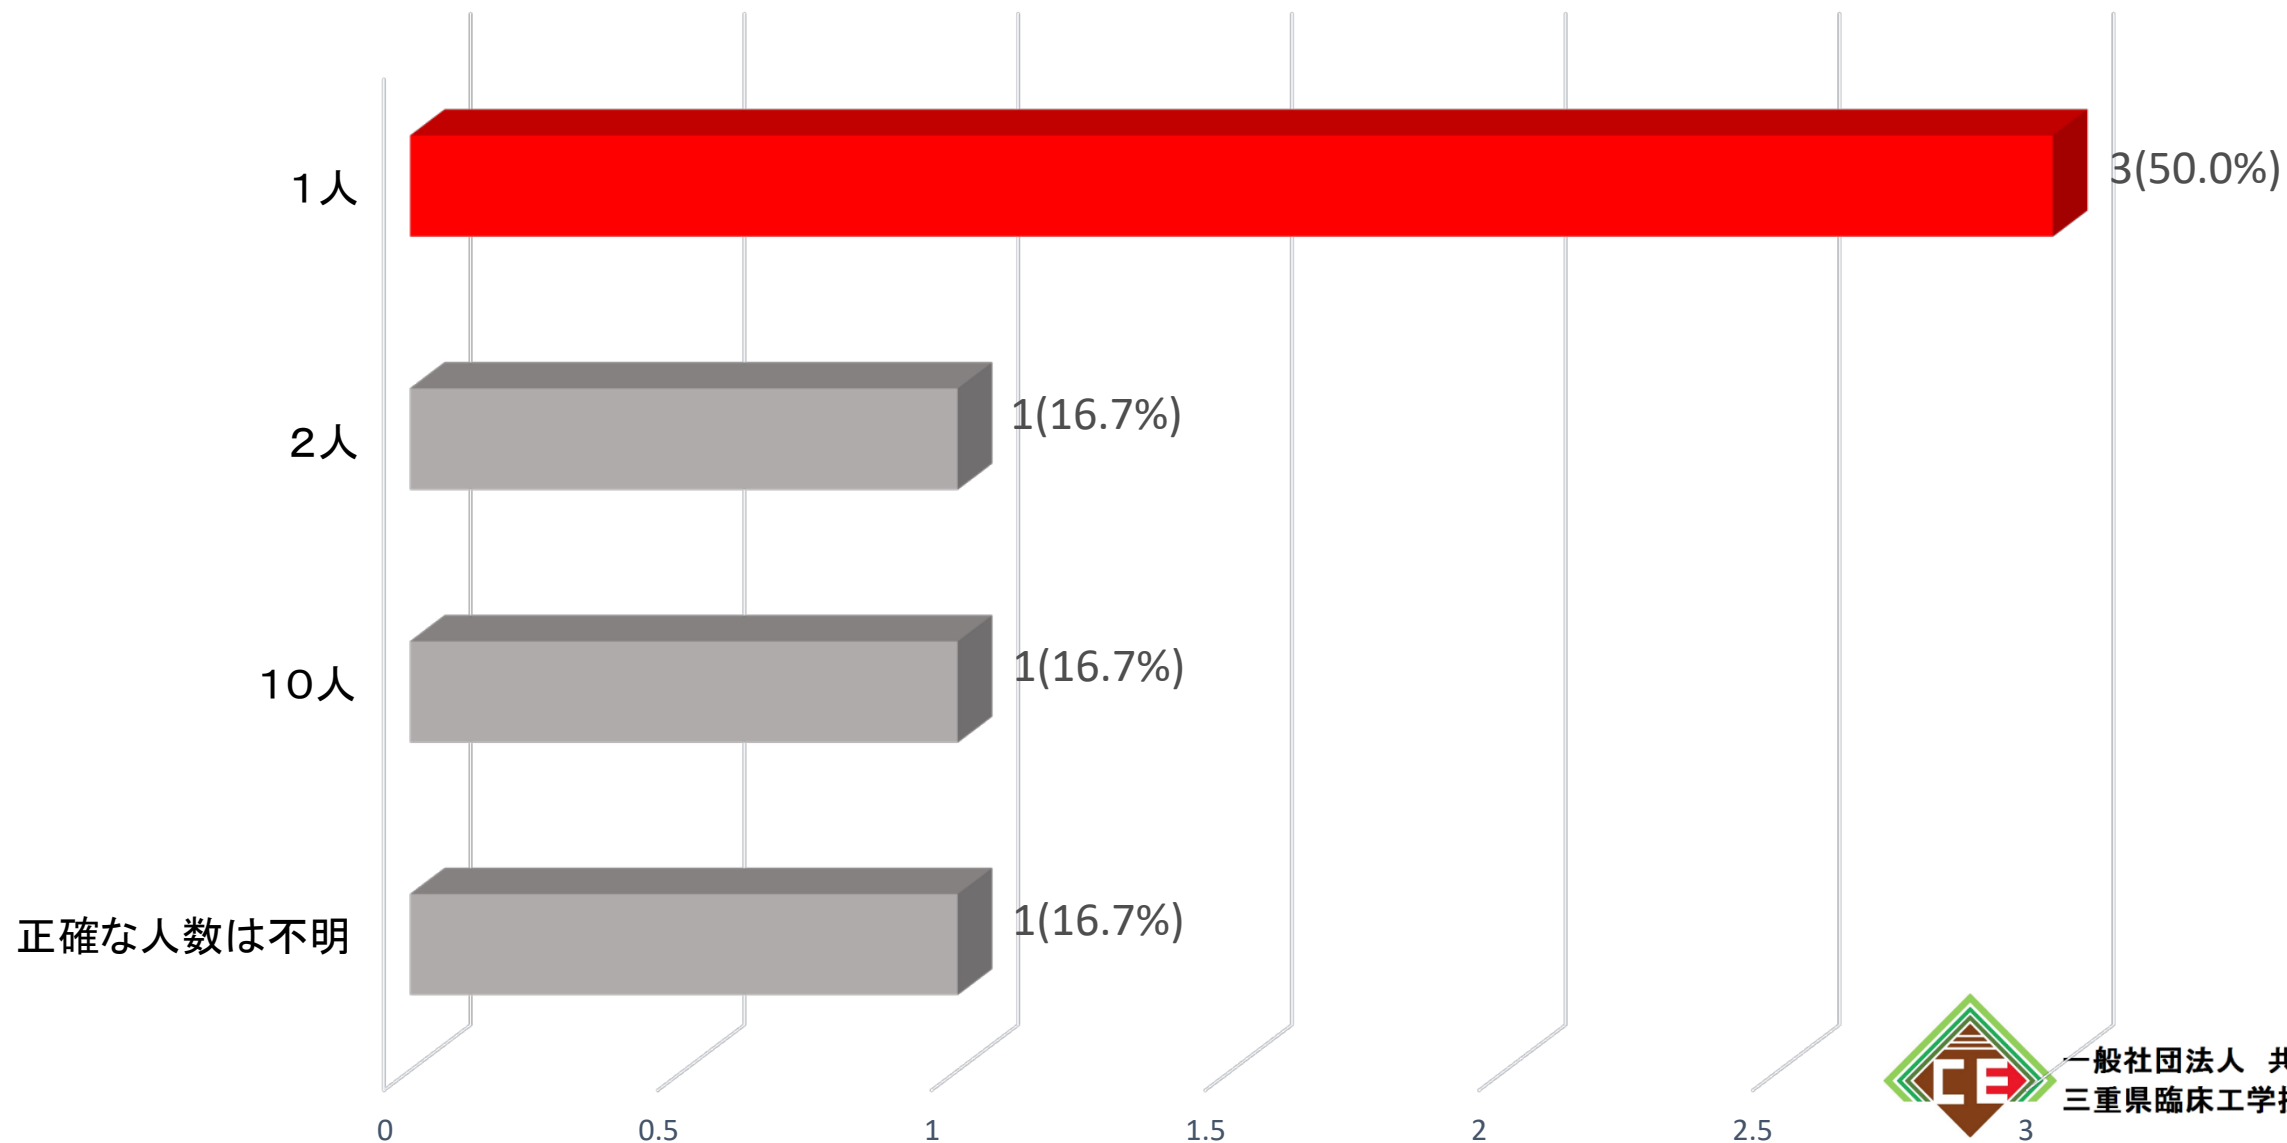


質問6. 外来透析患者の検温状況について、該当するものを
お答えください。複数回答可。

(29件 回答)

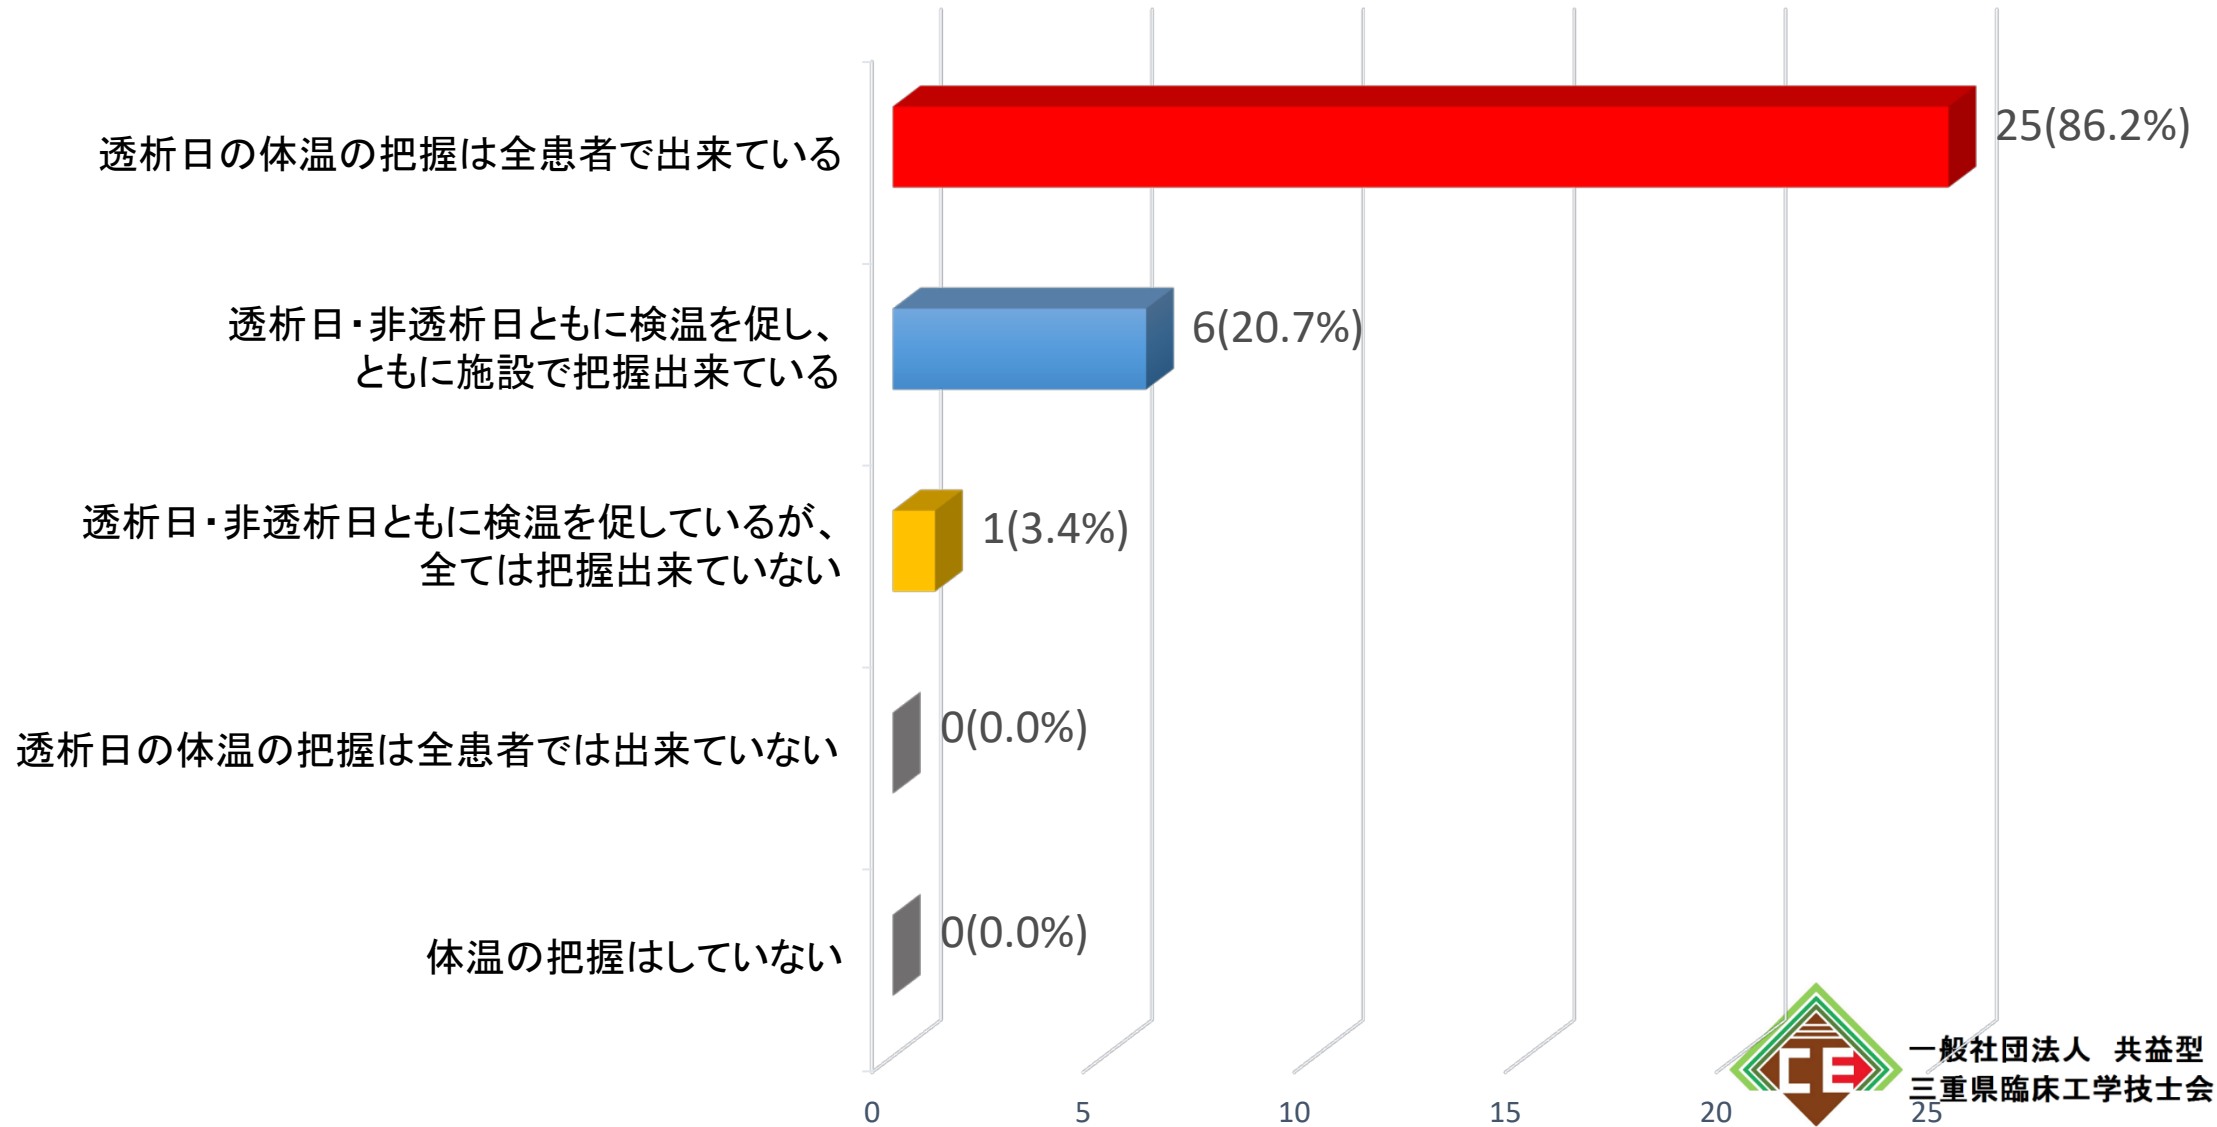

質問7. 外来透析患者の発熱や感冒症状の継続時の対応で


該当するものをお答えください。複数回答可。(29件 回答)

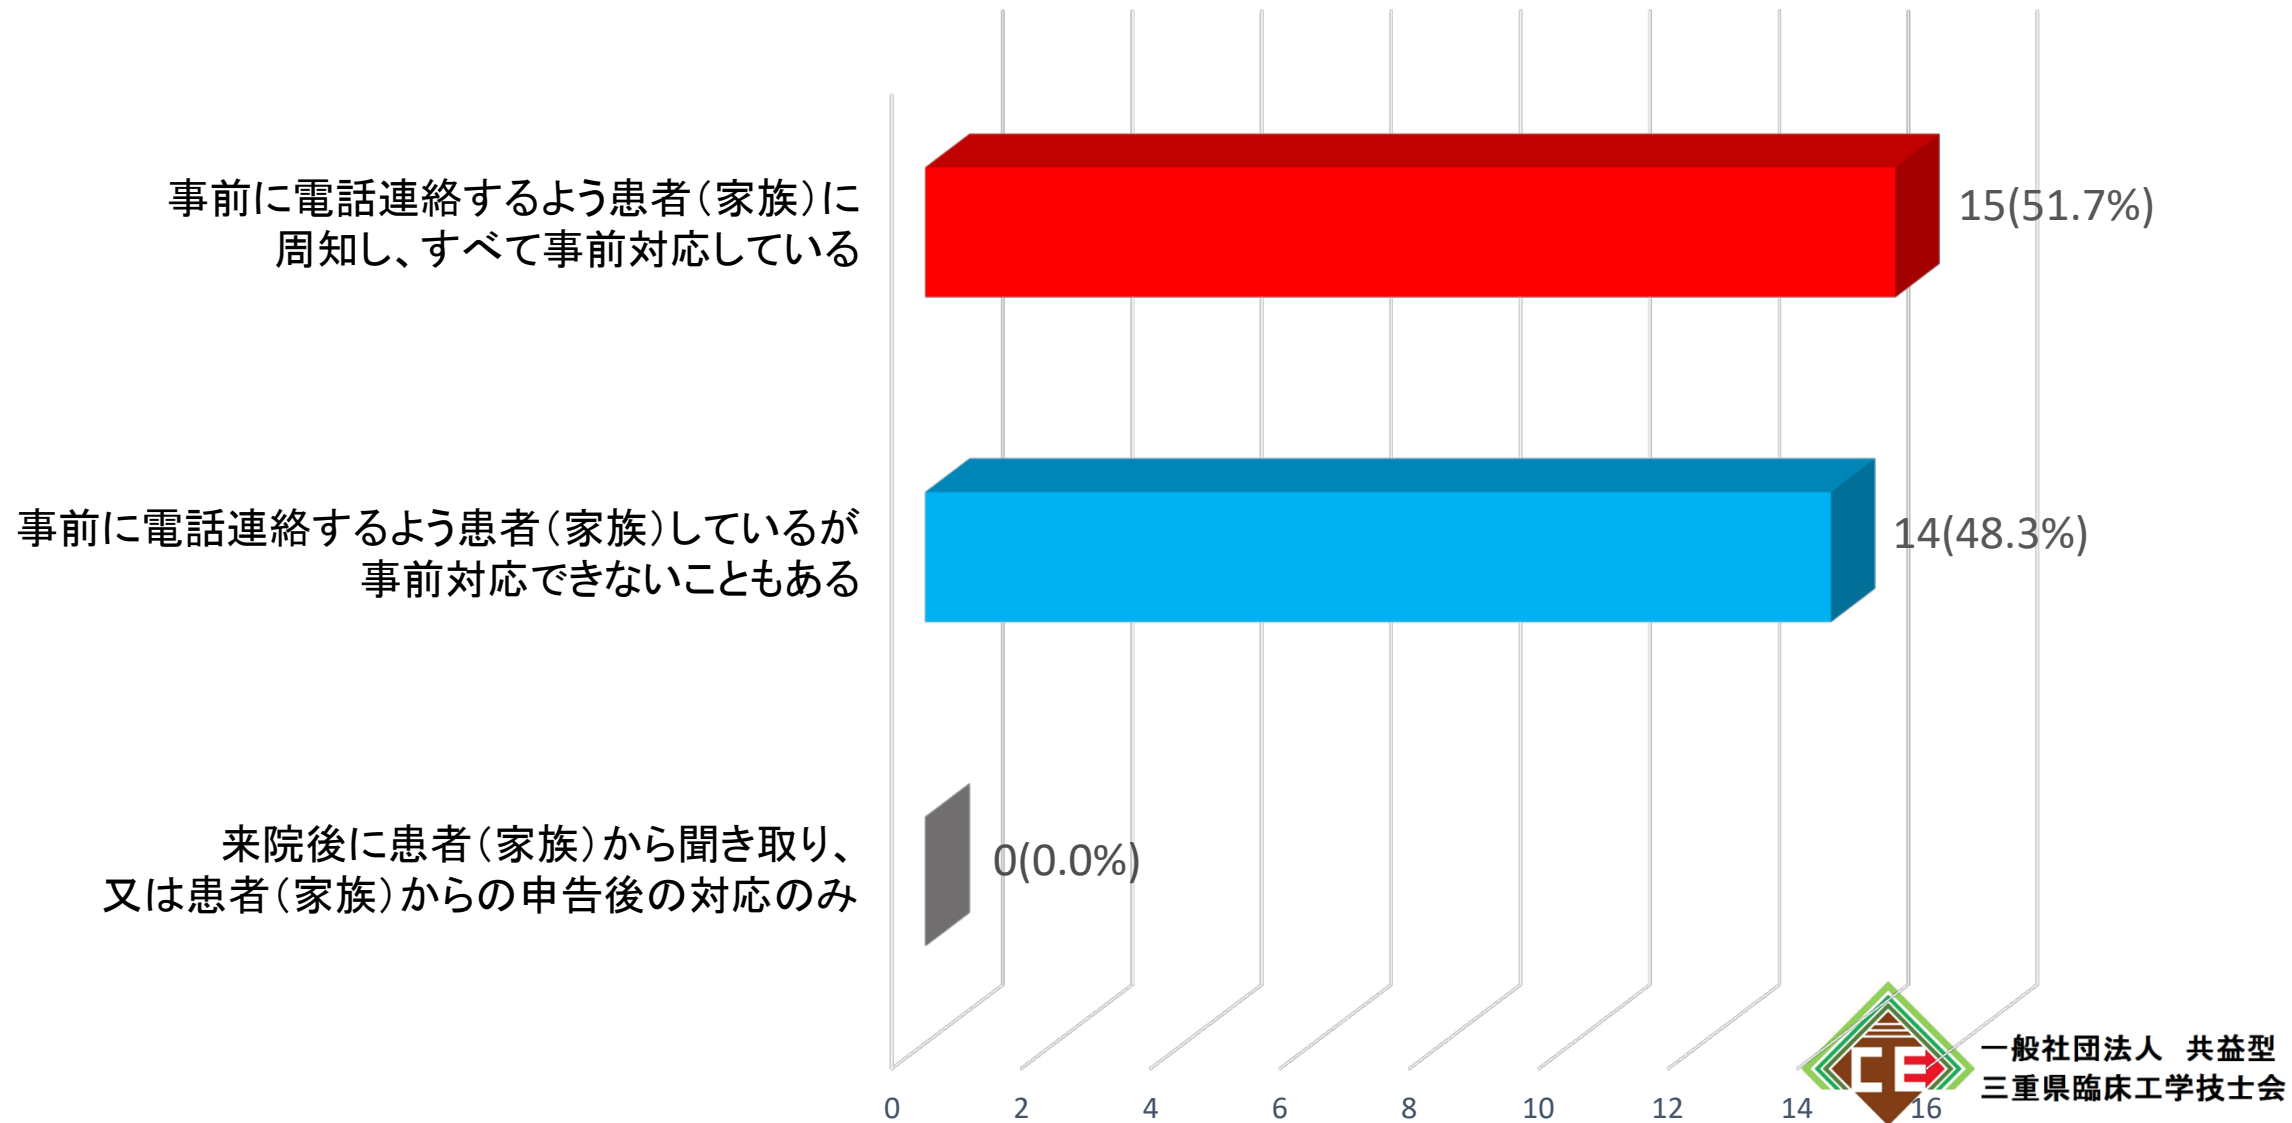

質問8. 隔離透析を行う場合、該当するものをお答えください。

複数回答可。


(31件 回答)

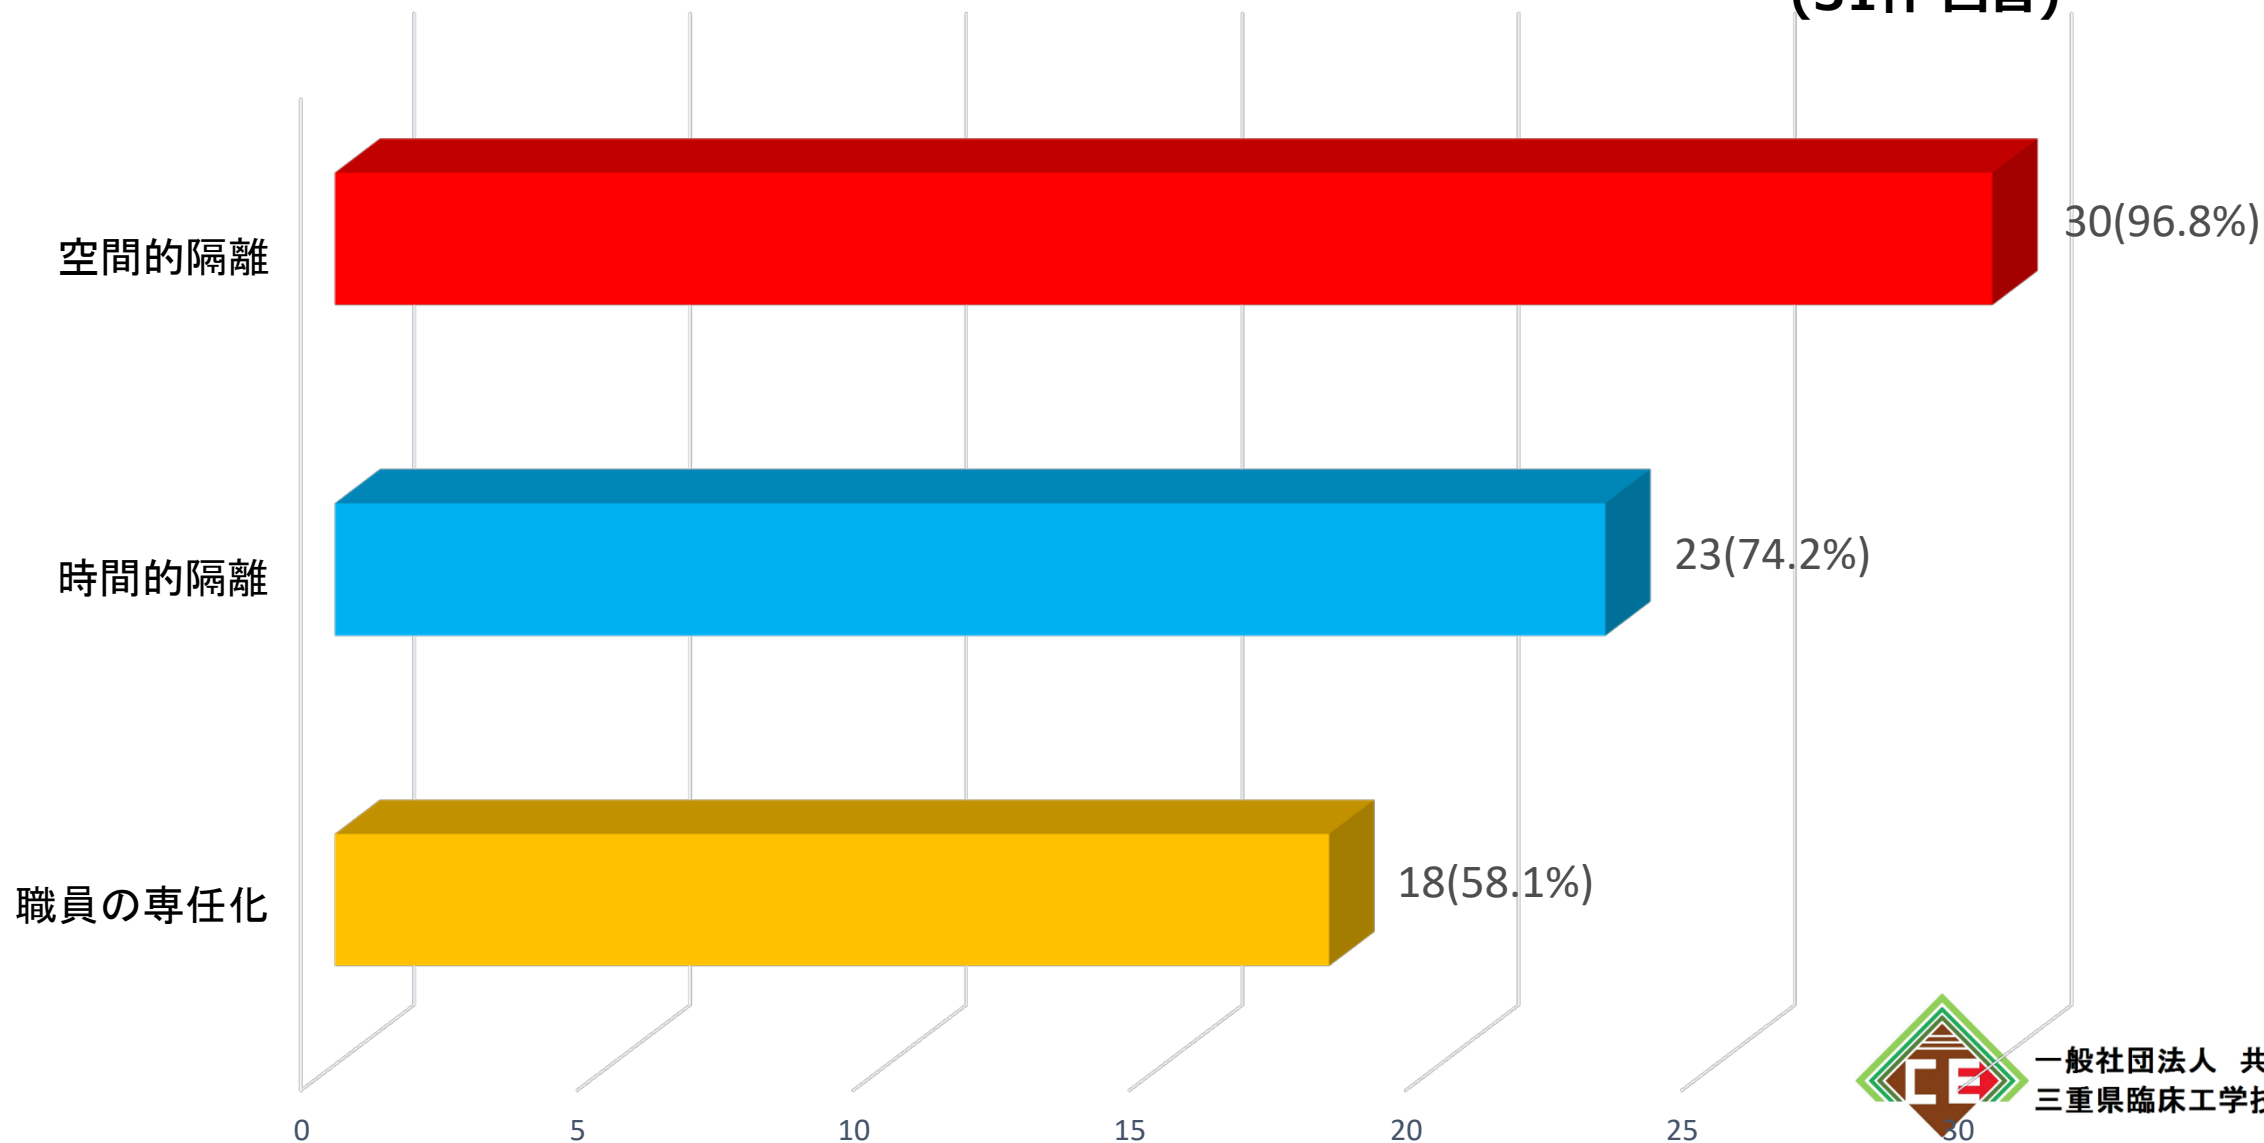

質問9. 質問8で「空間的隔離」とお答えいただいた場合、

以下の該当するものをお答えください。複数回答可。


(30件 回答)

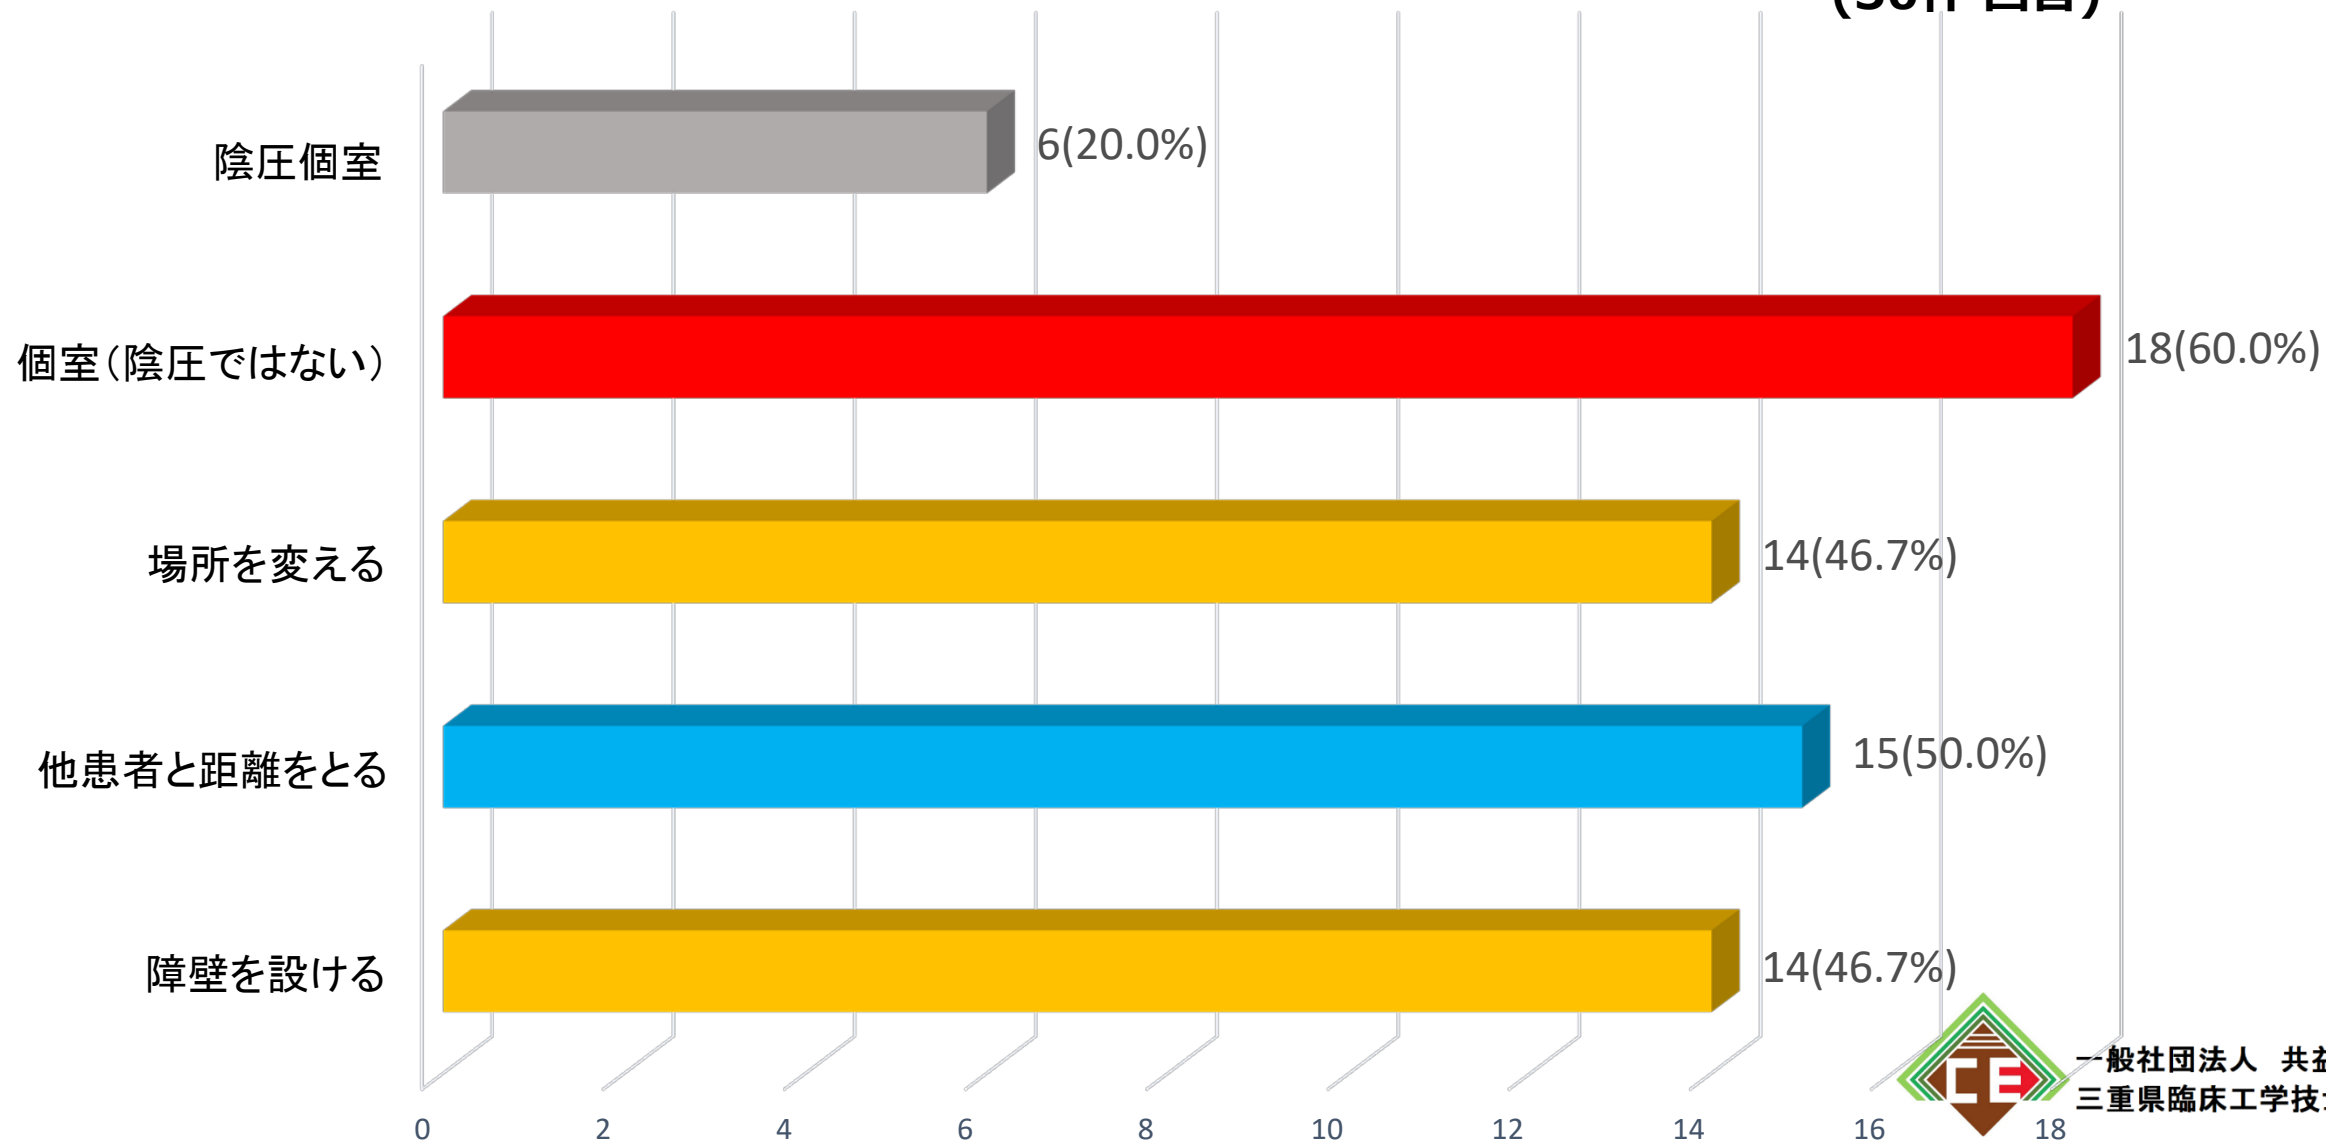

質問 10. 透析室内の衛生材料・備品等のうち、現在不足して

いるものがあればお答えください。複数回答可。


(31件 回答)

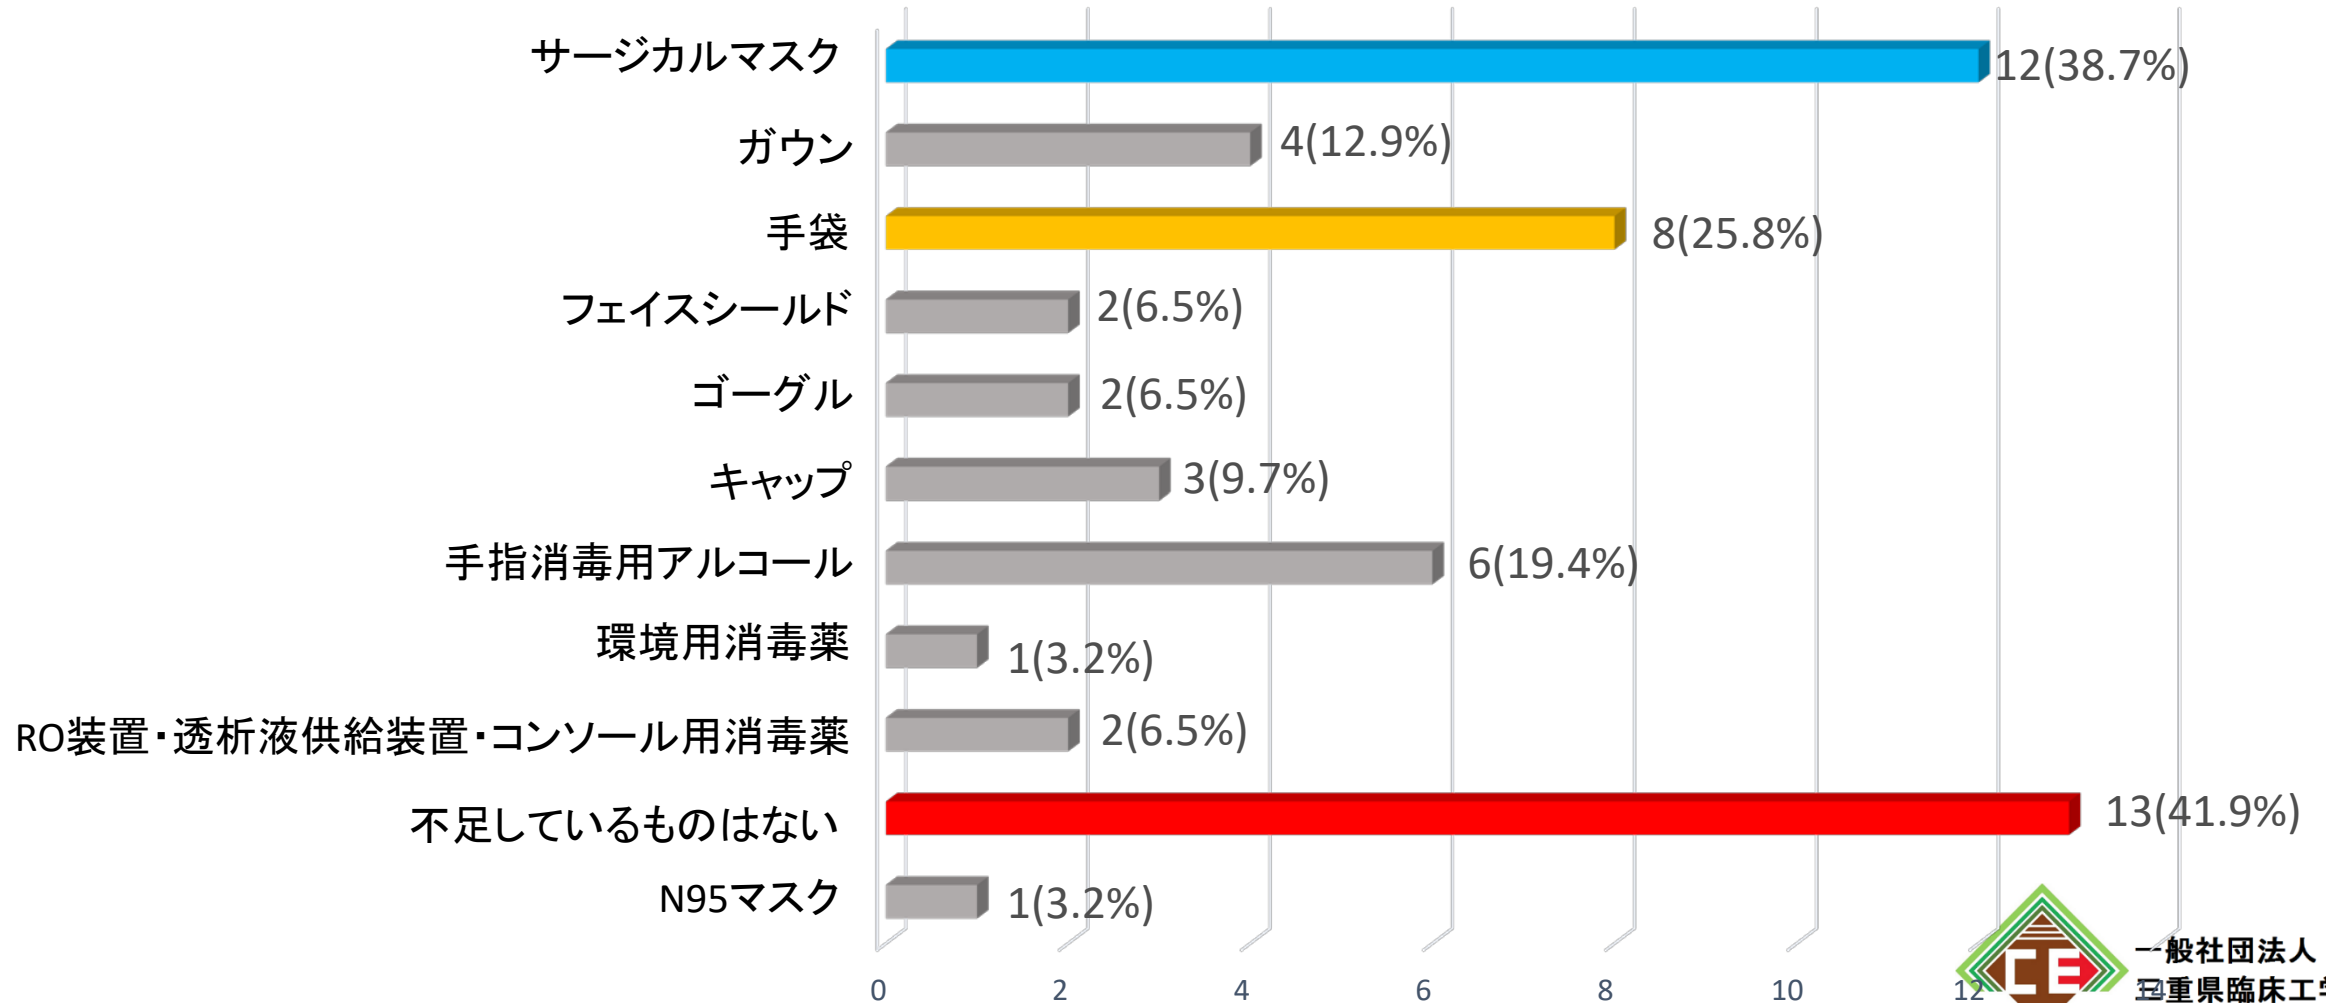


質問 1 1. 透析室内の衛生材料・備品等のうち、今後不足が予測

されるものがあればお答えください。複数回答可。

(31件 回答)

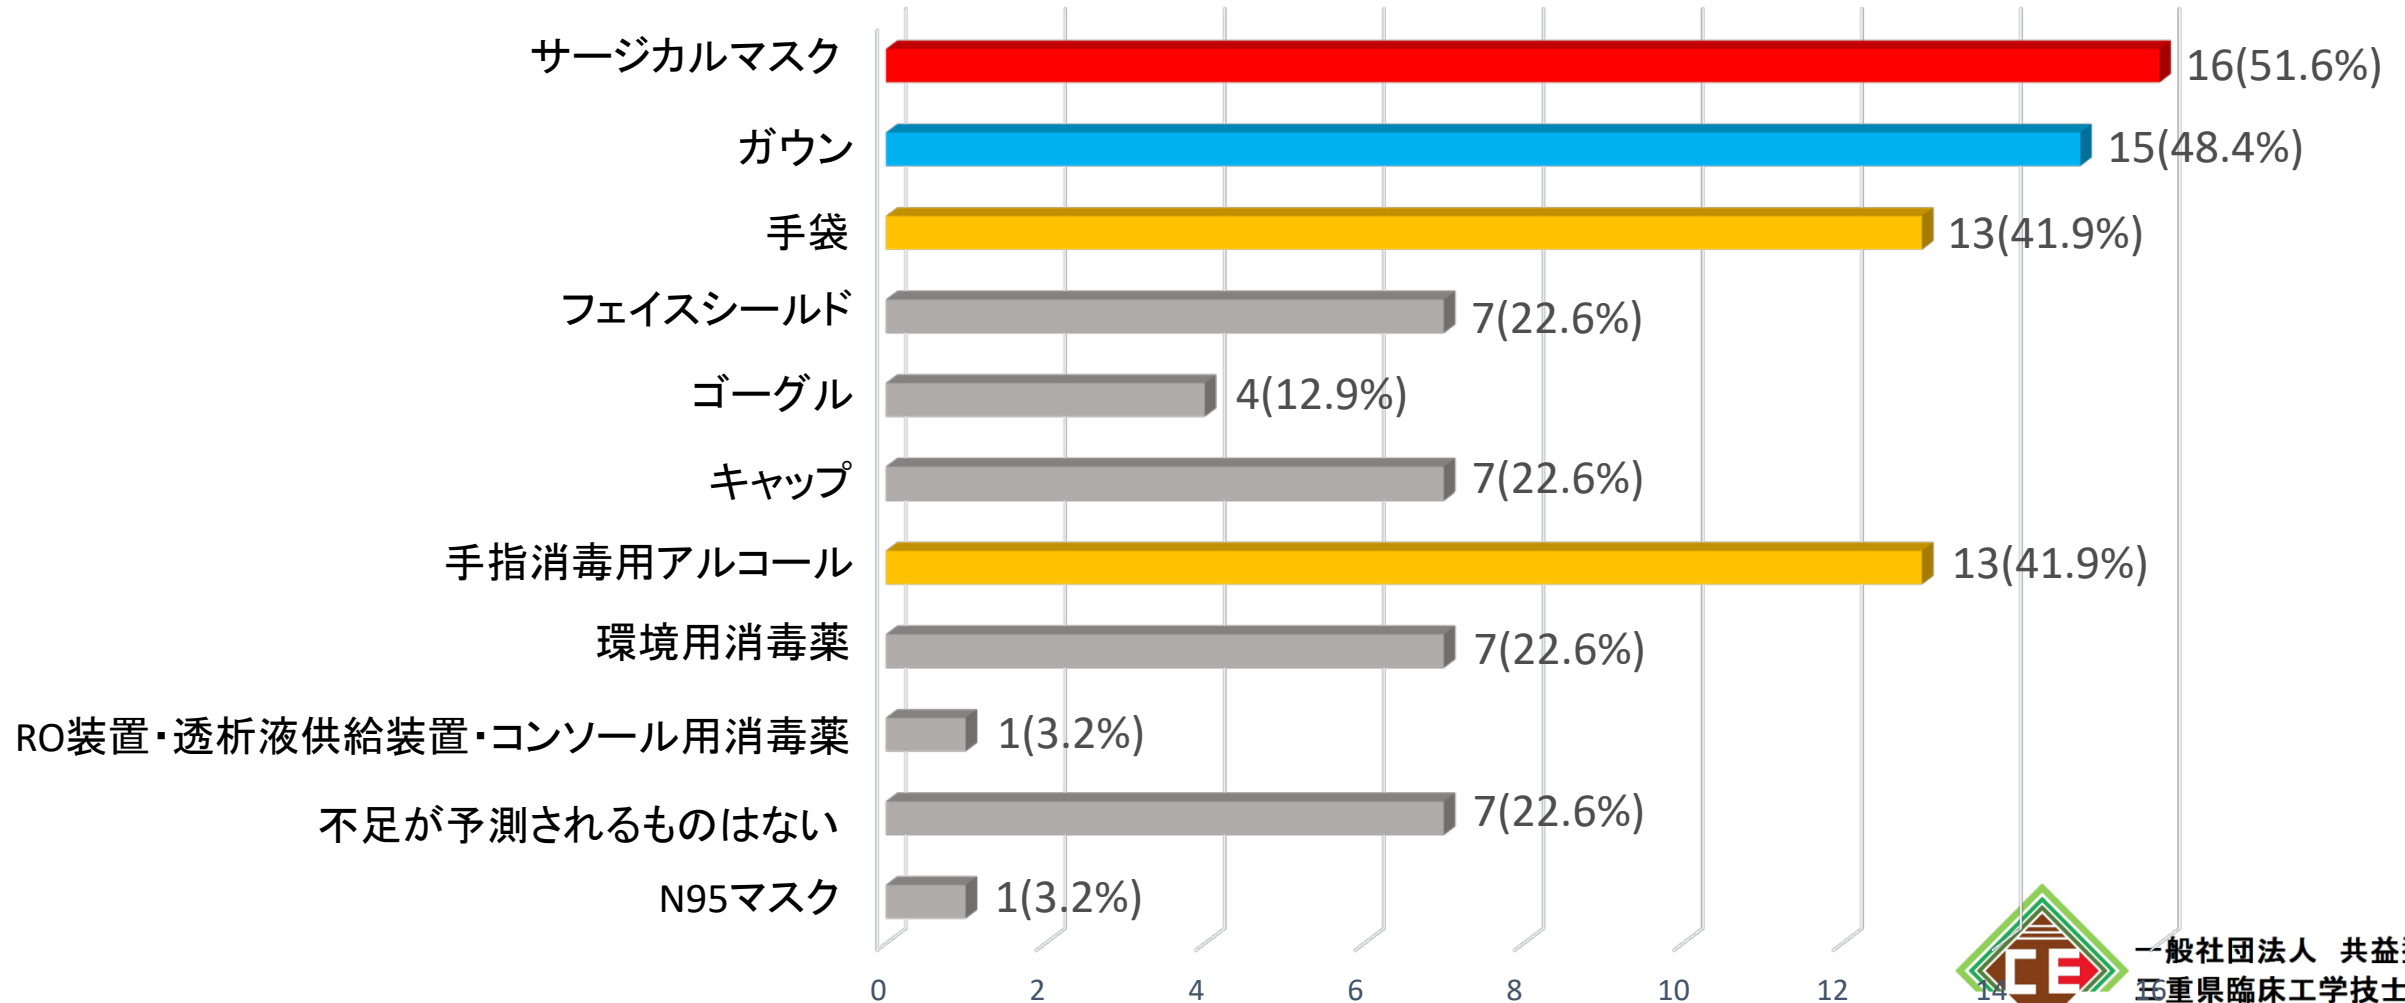


質問 12. 透析患者に対し、現在行っている飛沫感染予防策で 該当するものをお答えください。複数回答可。

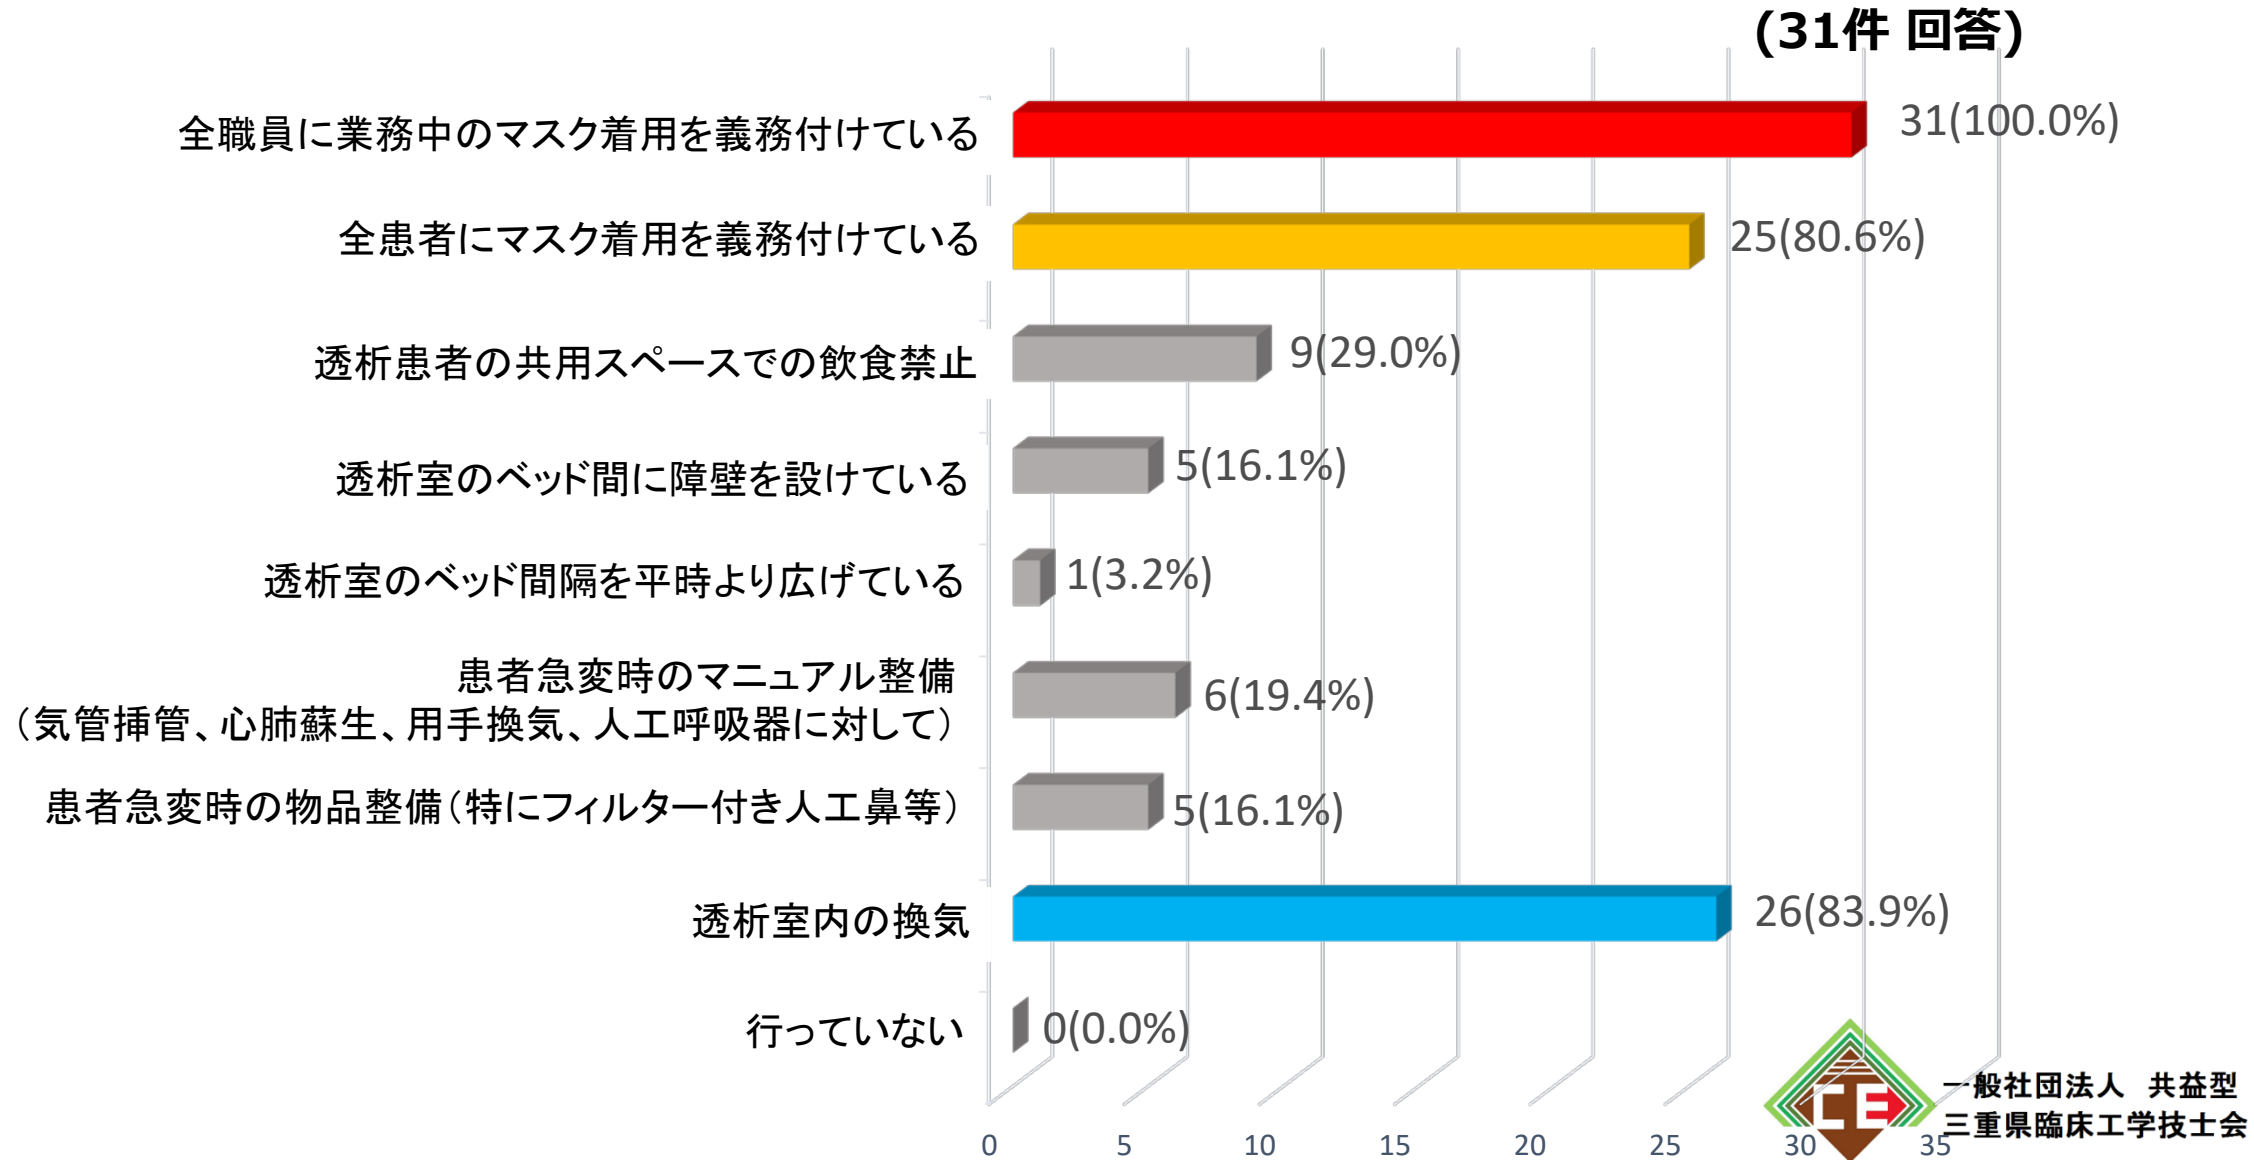


質問13. 透析室内の換気について該当するものをお答え ください。複数回答可。

(31件 回答)

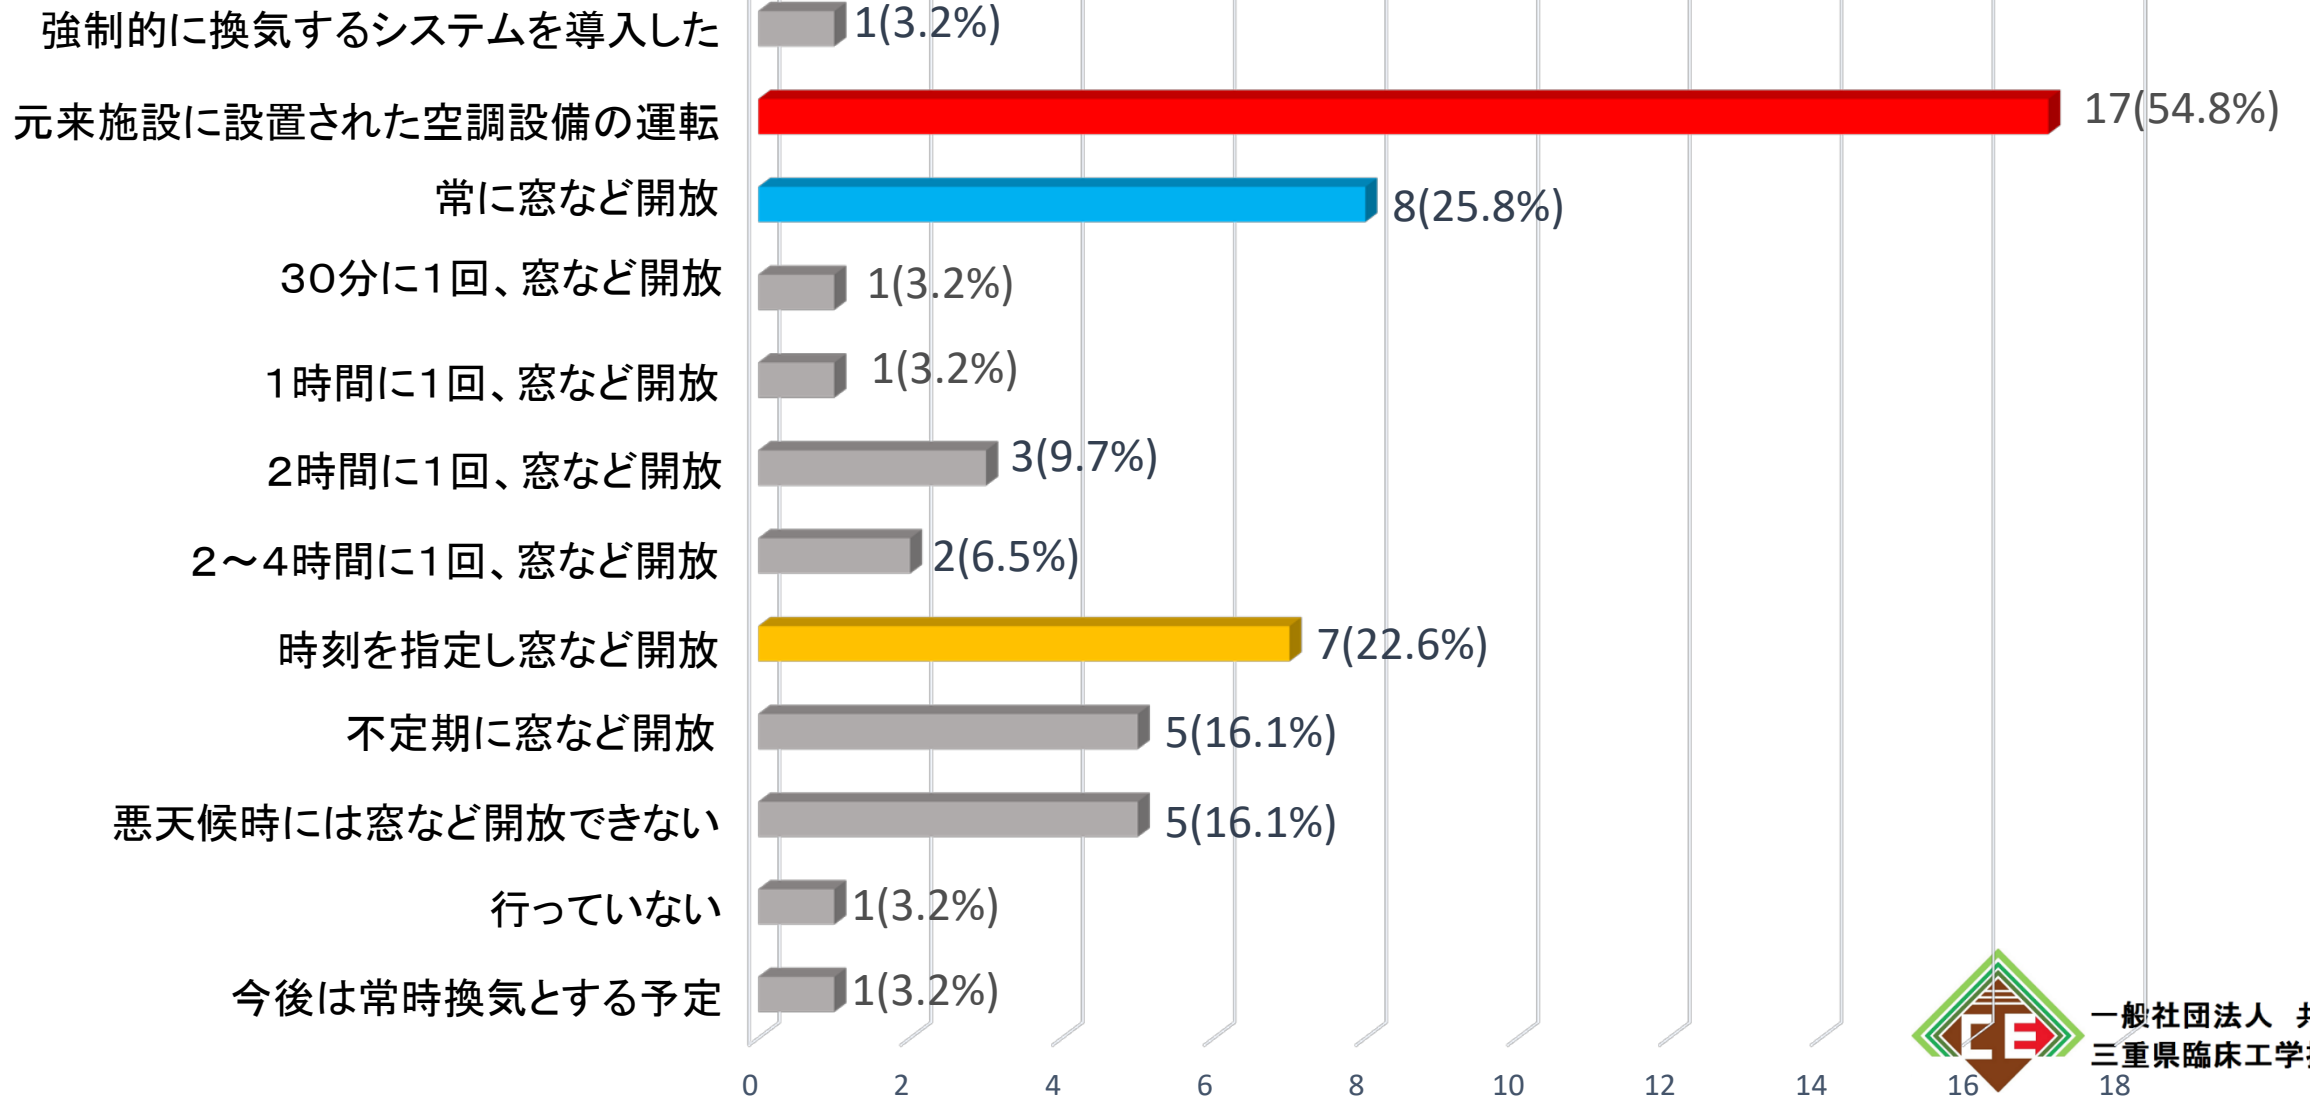


質問14. 質問13で「窓など開放」とお答えいただいた場合、
1回の開放時間をお答え下さい。

(22件 回答)

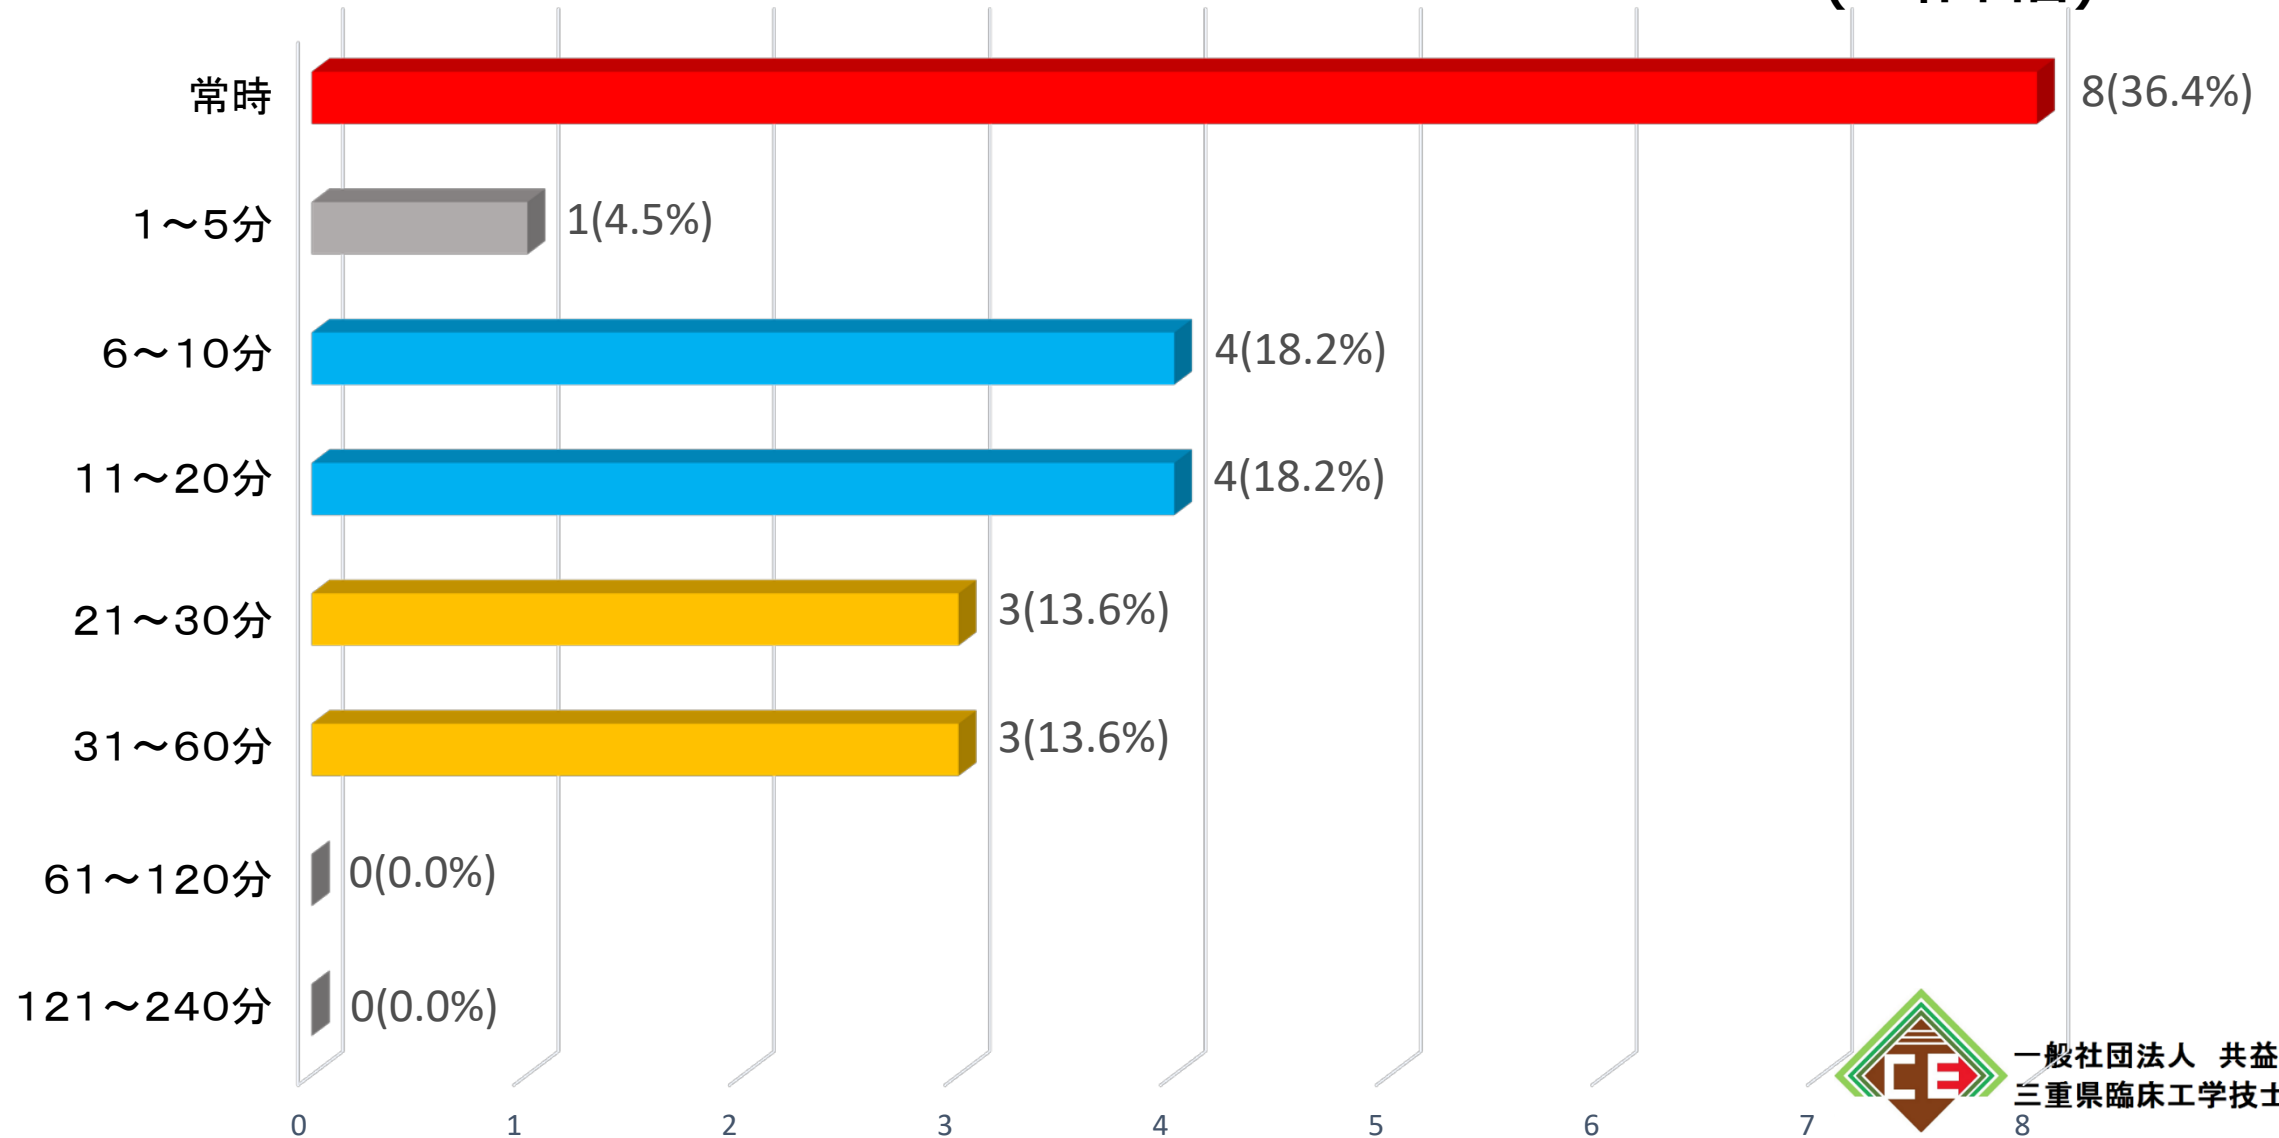


質問 15. 透析室や待合室などで現在行っている接触感染

予防策で該当するものをお答えください。複数回答可。

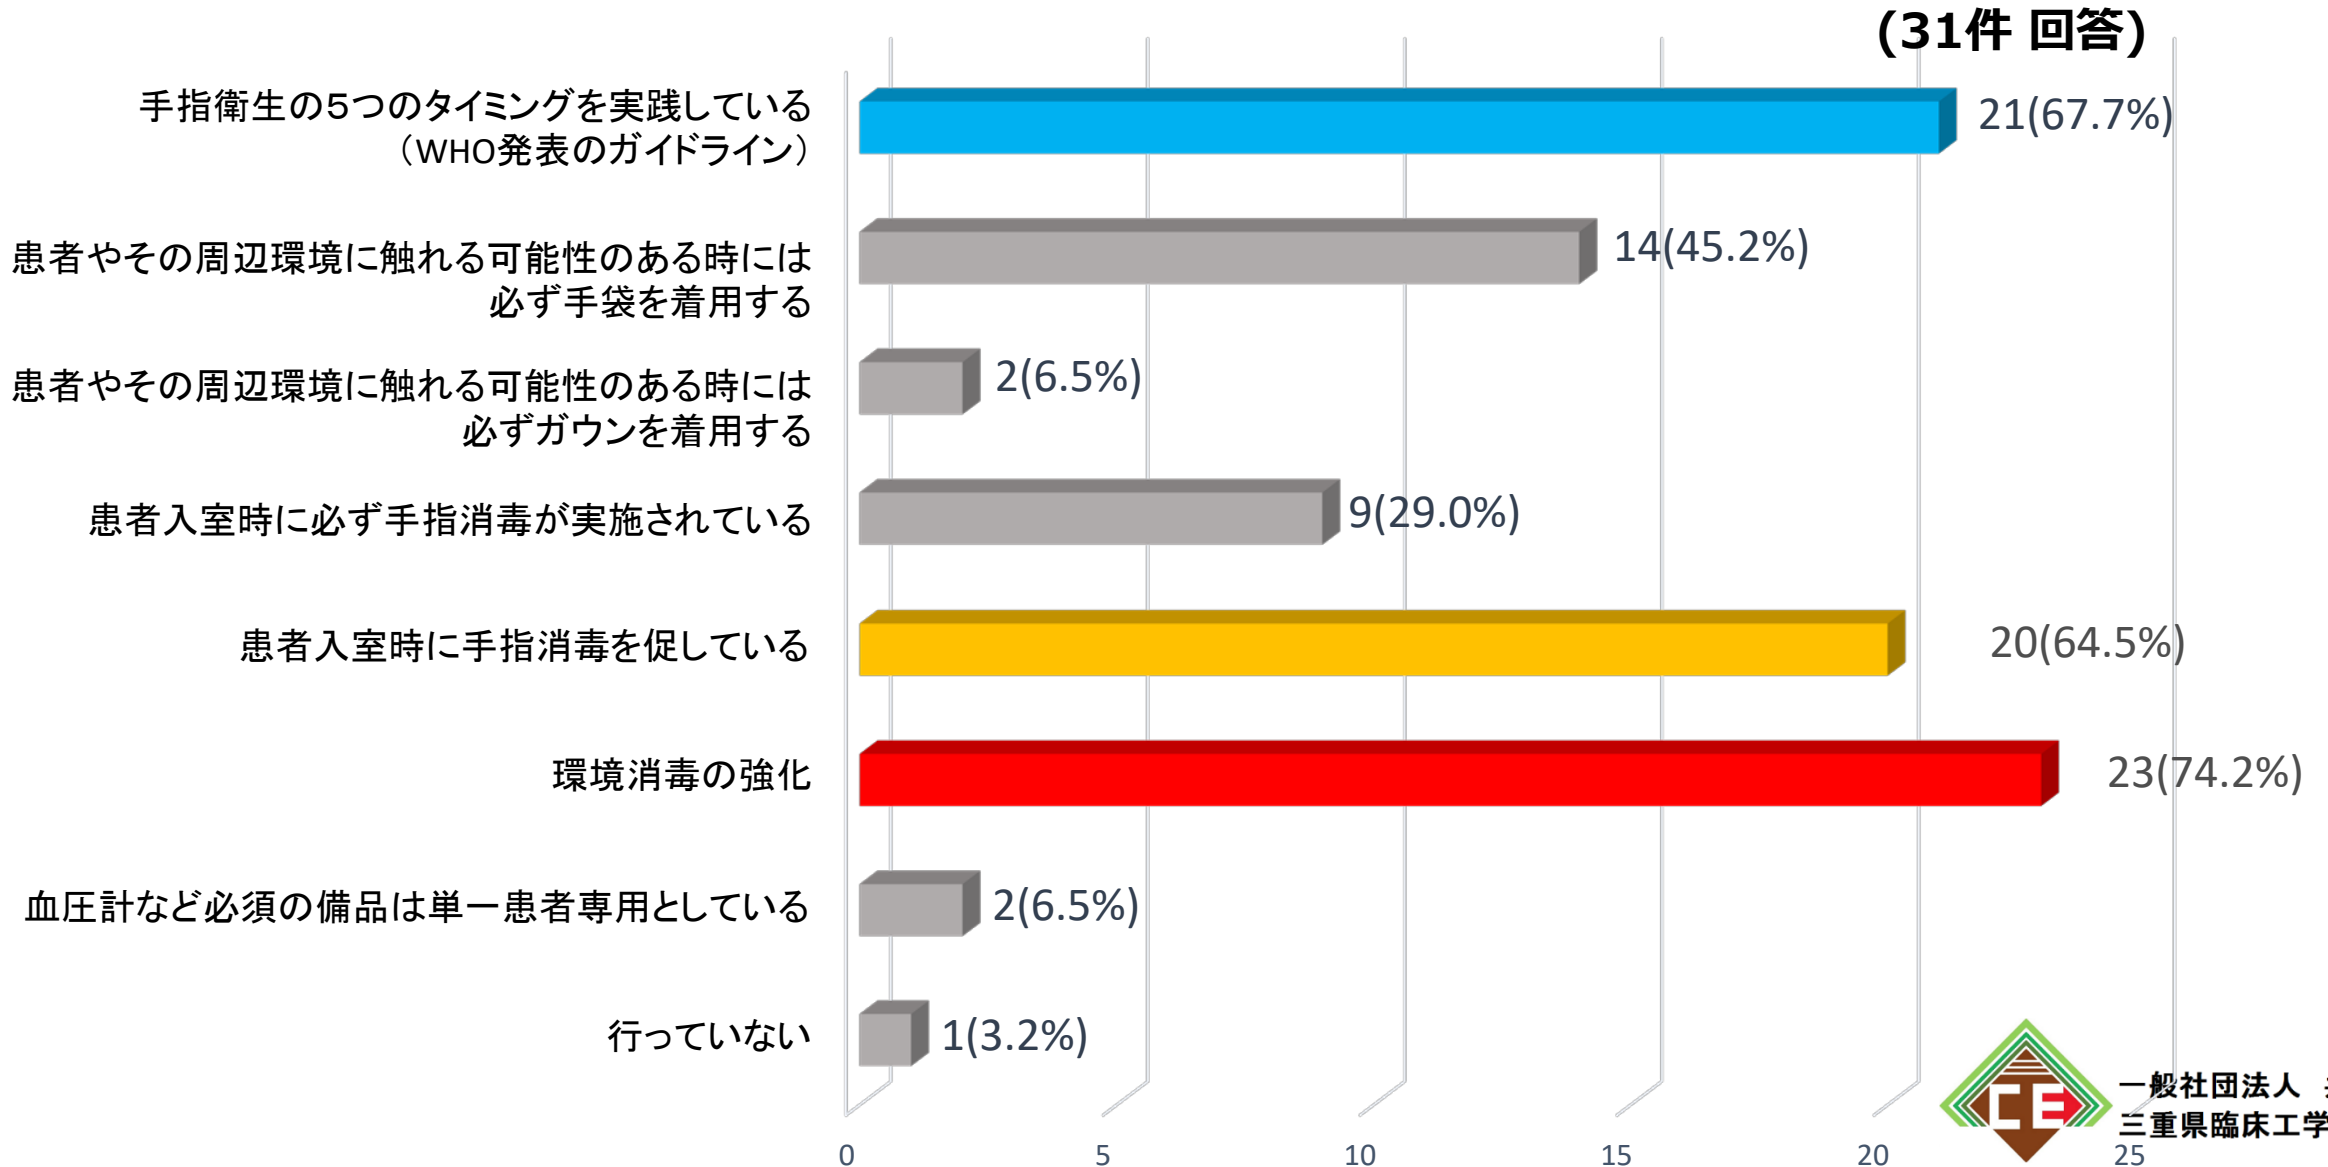


質問 16. 質問 15で「環境消毒の強化」とお答えの場合、血液・体液
汚染がなくとも現在実施している整備場所と使用する消毒薬
等の分類で該当するものをお答えください。複数回答可。

※質問 17の回答も含む

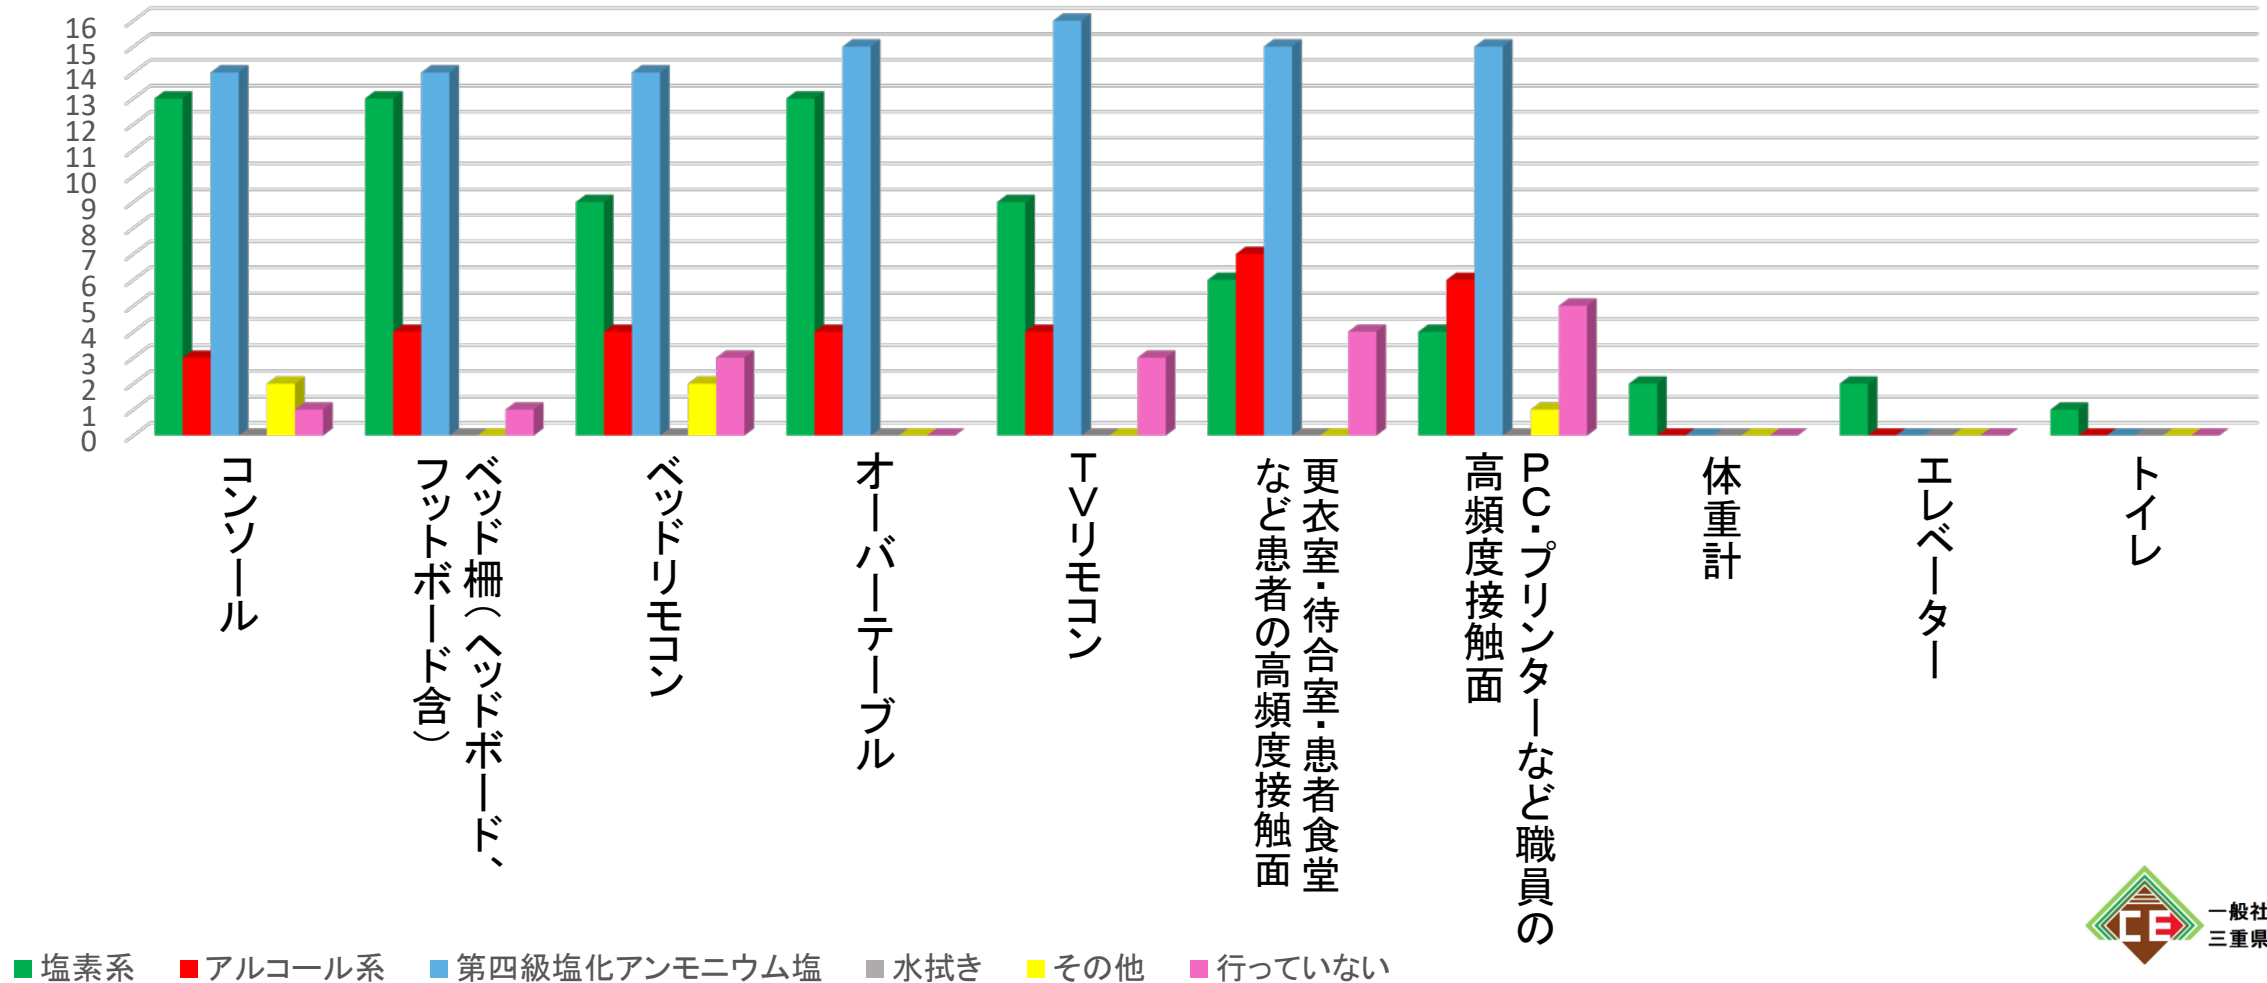


質問 18. 透析室内のベッド環境整備について、血液・体液汚染がなくとも行っているリネン類（敷シーツ、掛シーツ、枕カバー）の交換頻度をお答えください。


(31件 回答)

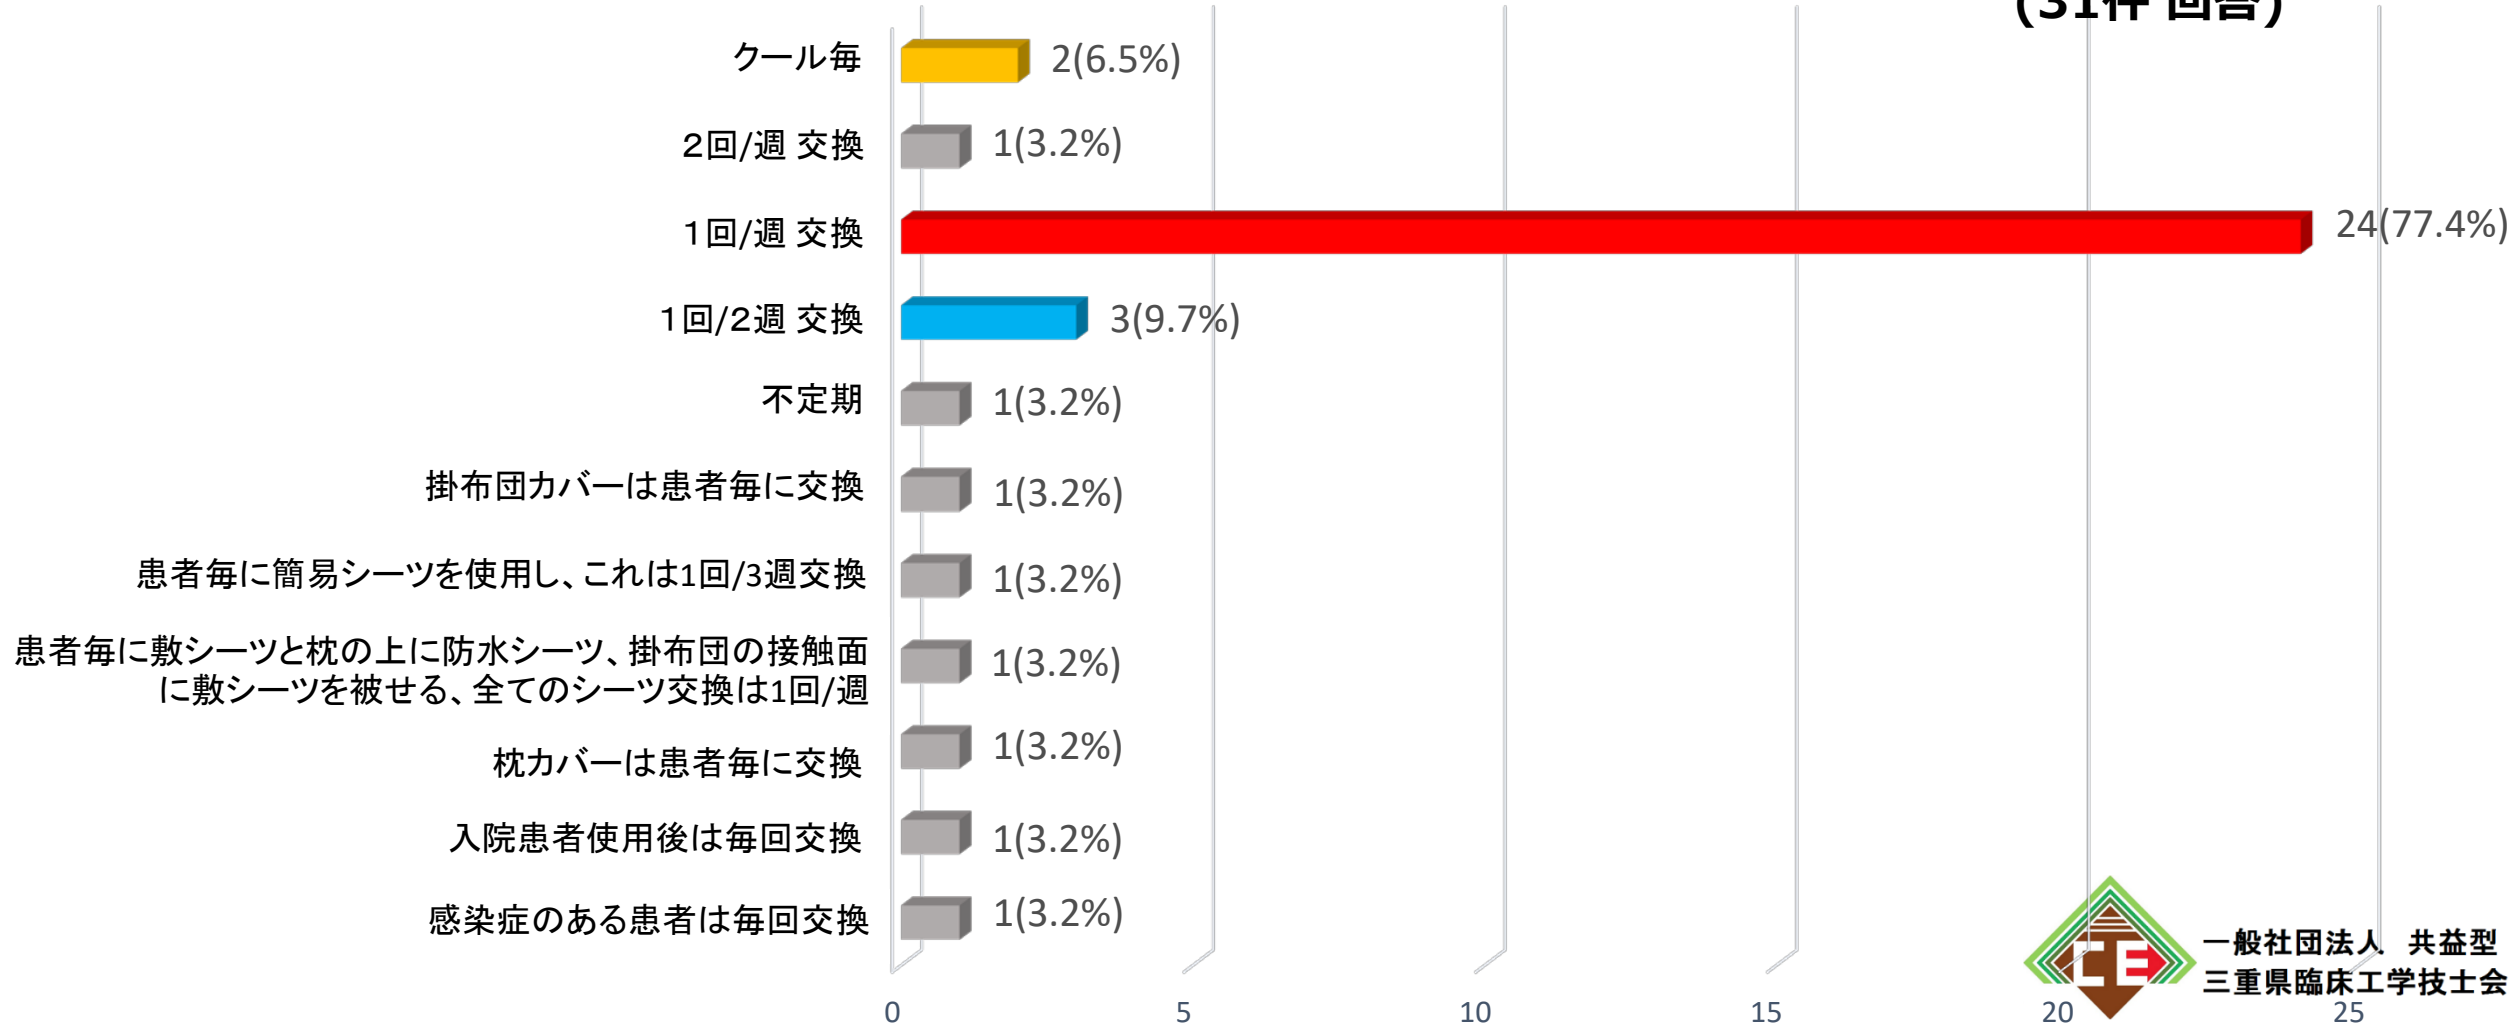

質問 19. チェアベッドを使用している場合、使用後に血液・
体液汚染がなくとも行っている処理で、該当する
ものをお答えください。

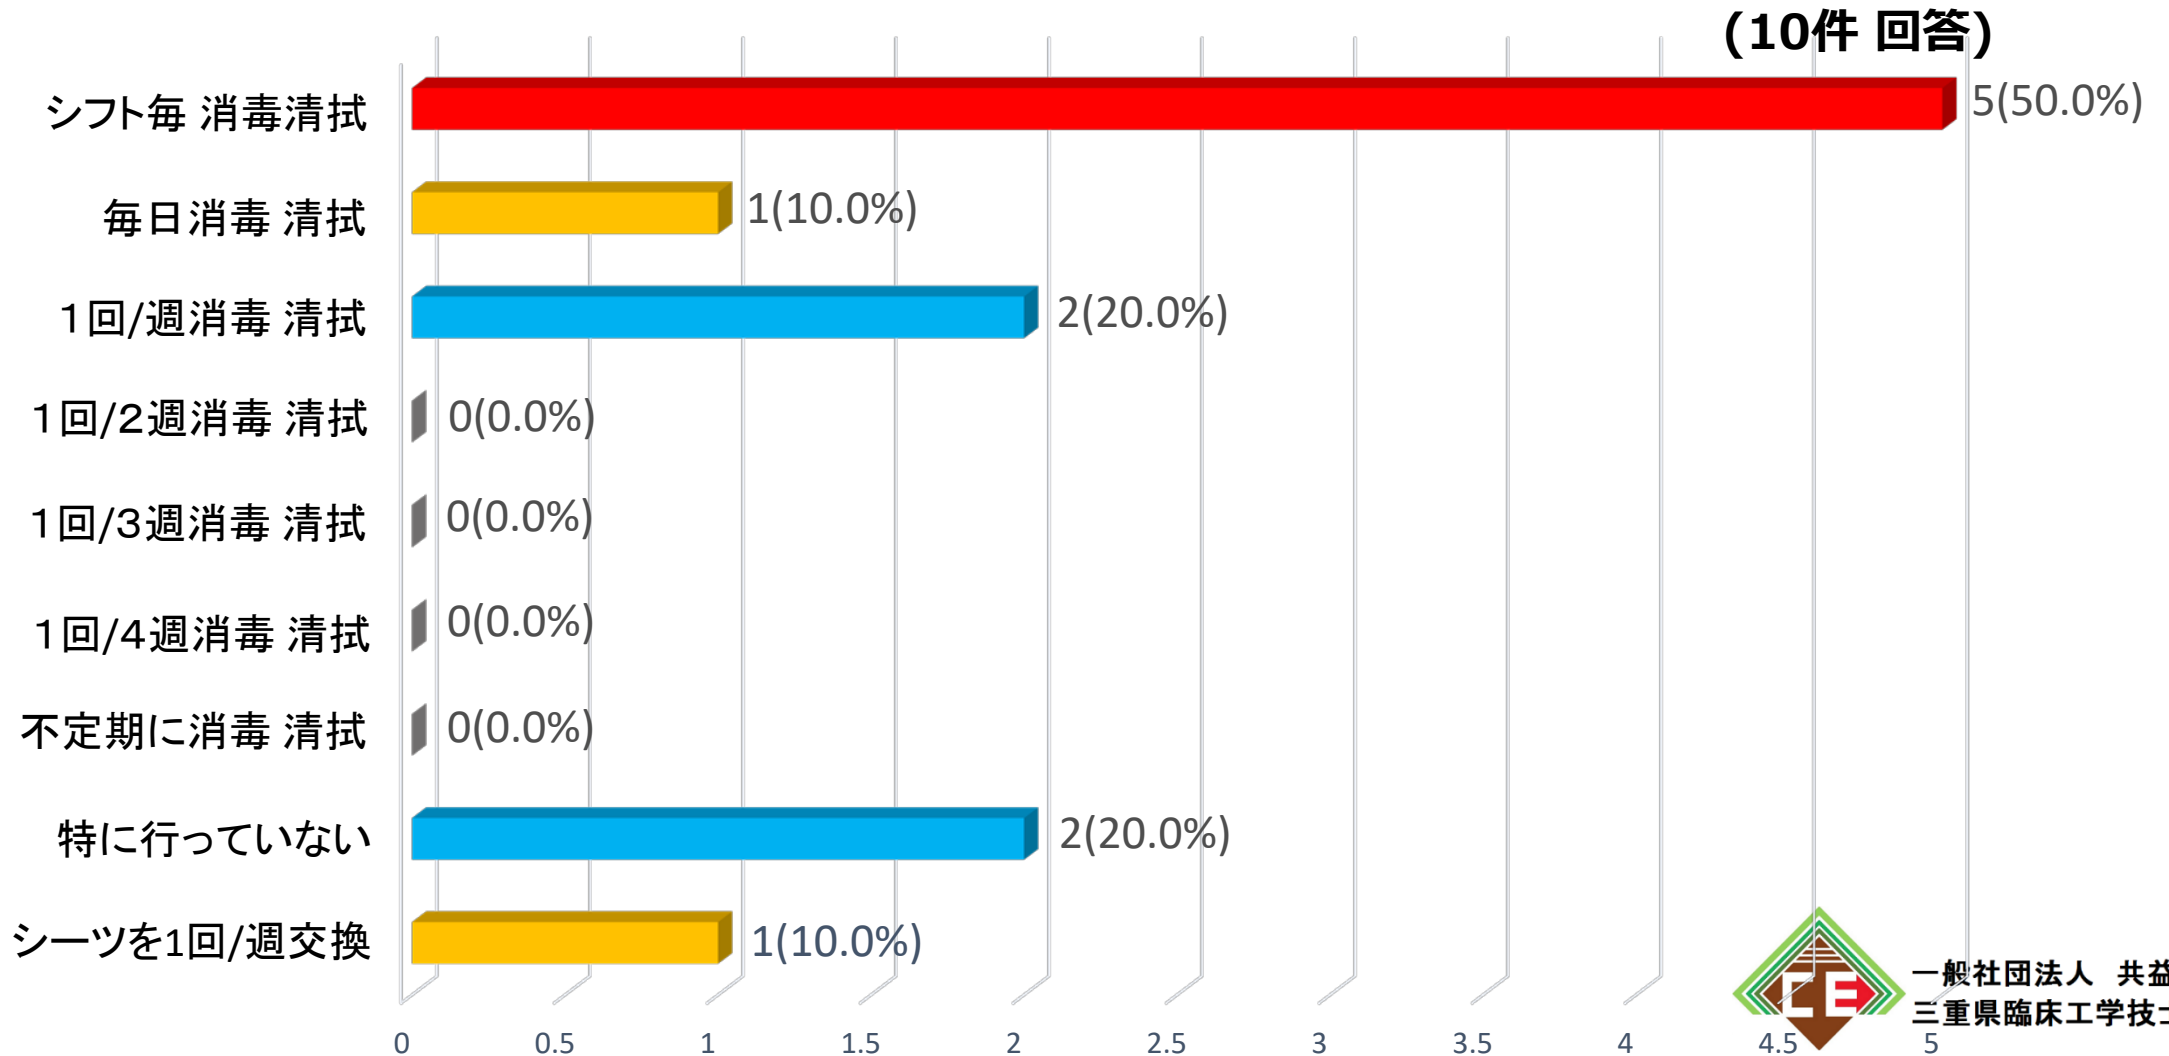

質問20. 透析患者の食事について、該当するものをお答えください。複数回答可。

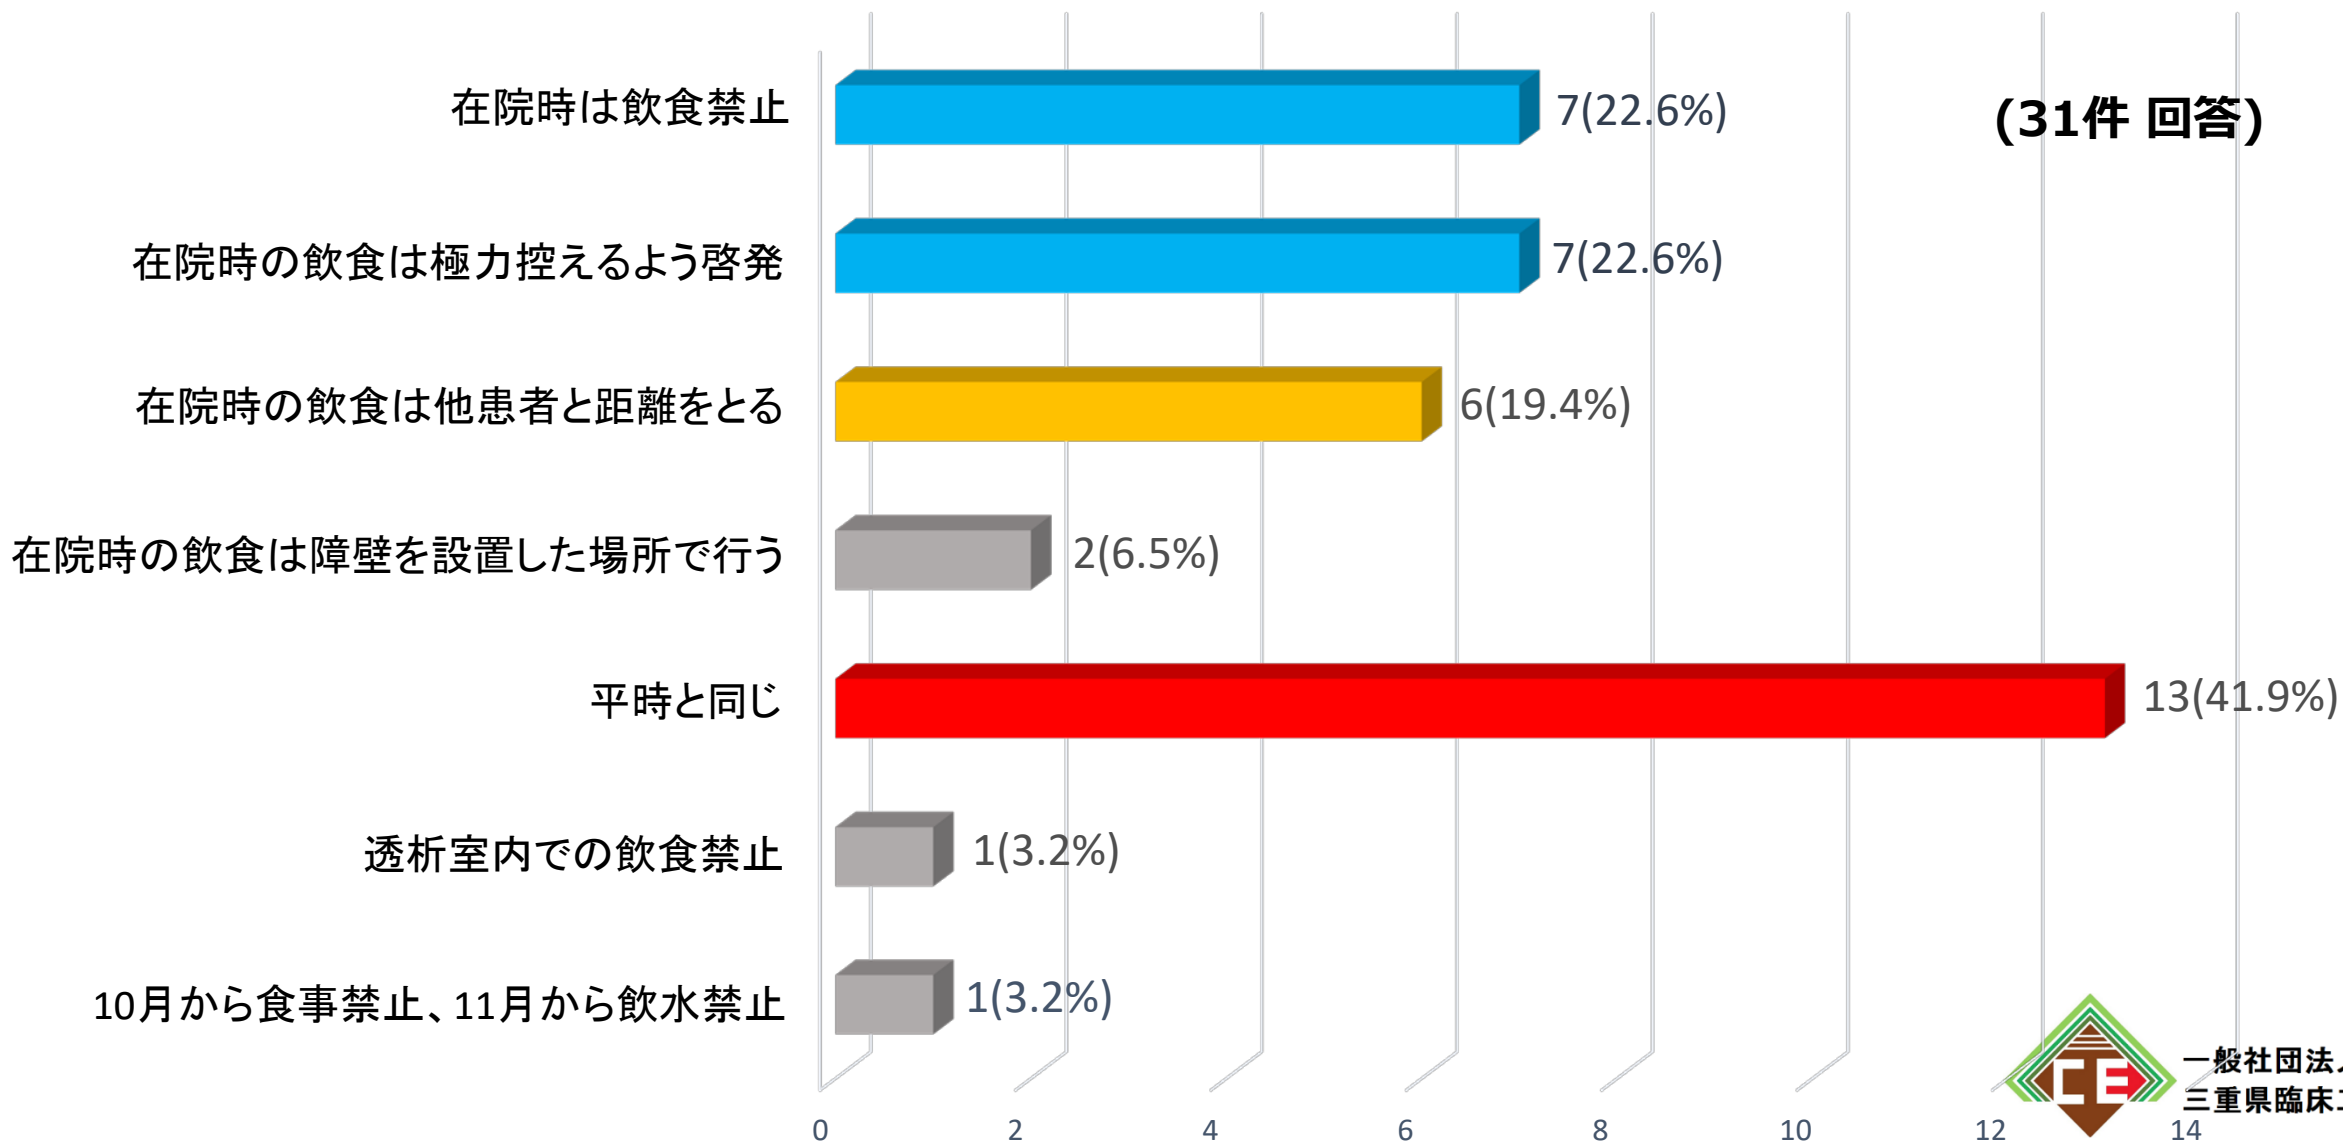

質問 21. 透析患者に対するCOVID-19対策で、本年5月2日以降新たに実施している取り組みがあればお答えください。

- ・透析前の体温37.5℃以上で別室に控え診察としていたが、体温37.0度にボーダーを変更
- ・入室時間の調節
- ・基本的にPPEで業務を行う
- ・毎日の検温の啓発
- ・透析毎にシーツ交換を実施
- ・院内での飲食禁止
- ・感染対策マニュアルが完成した
ICT・院内感染委員会等と連携しており、院内の感染対策マニュアルの透析室での対策として認可された
- ・隔離透析におけるマニュアル整備、患者動線や院内周知
- ・アイシールドの使用
- ・入館、入室時の検温
- ・更衣室の使用制限（同時2名まで）
- ・送迎バスの乗車人数制限（5名まで）
- ・カーテン、網戸の設置
- ・環境整備（施設内清掃、空調環境）



質問 2 2. 透析患者の日常生活におけるCOVID-19対策として、 行っている指導・依頼などがあればお答えください。


- ・ 自宅での検温、体温37.5℃以上は電話連絡
- ・ 体調管理と連絡体制
- ・ 3密や不要不急の外出は避けるよう促す
- ・ 手指衛生、うがいの強化
- ・ 県外への移動、訪問者との接触は避けるよう促す
- ・ マスクの常時着用
- ・ 体調管理等の案内文書を提示



質問 2 3. 透析室以外で、職員が密集しやすい場所での換気


状況で該当するものをお答えください。複数回答可。

(31件 回答)

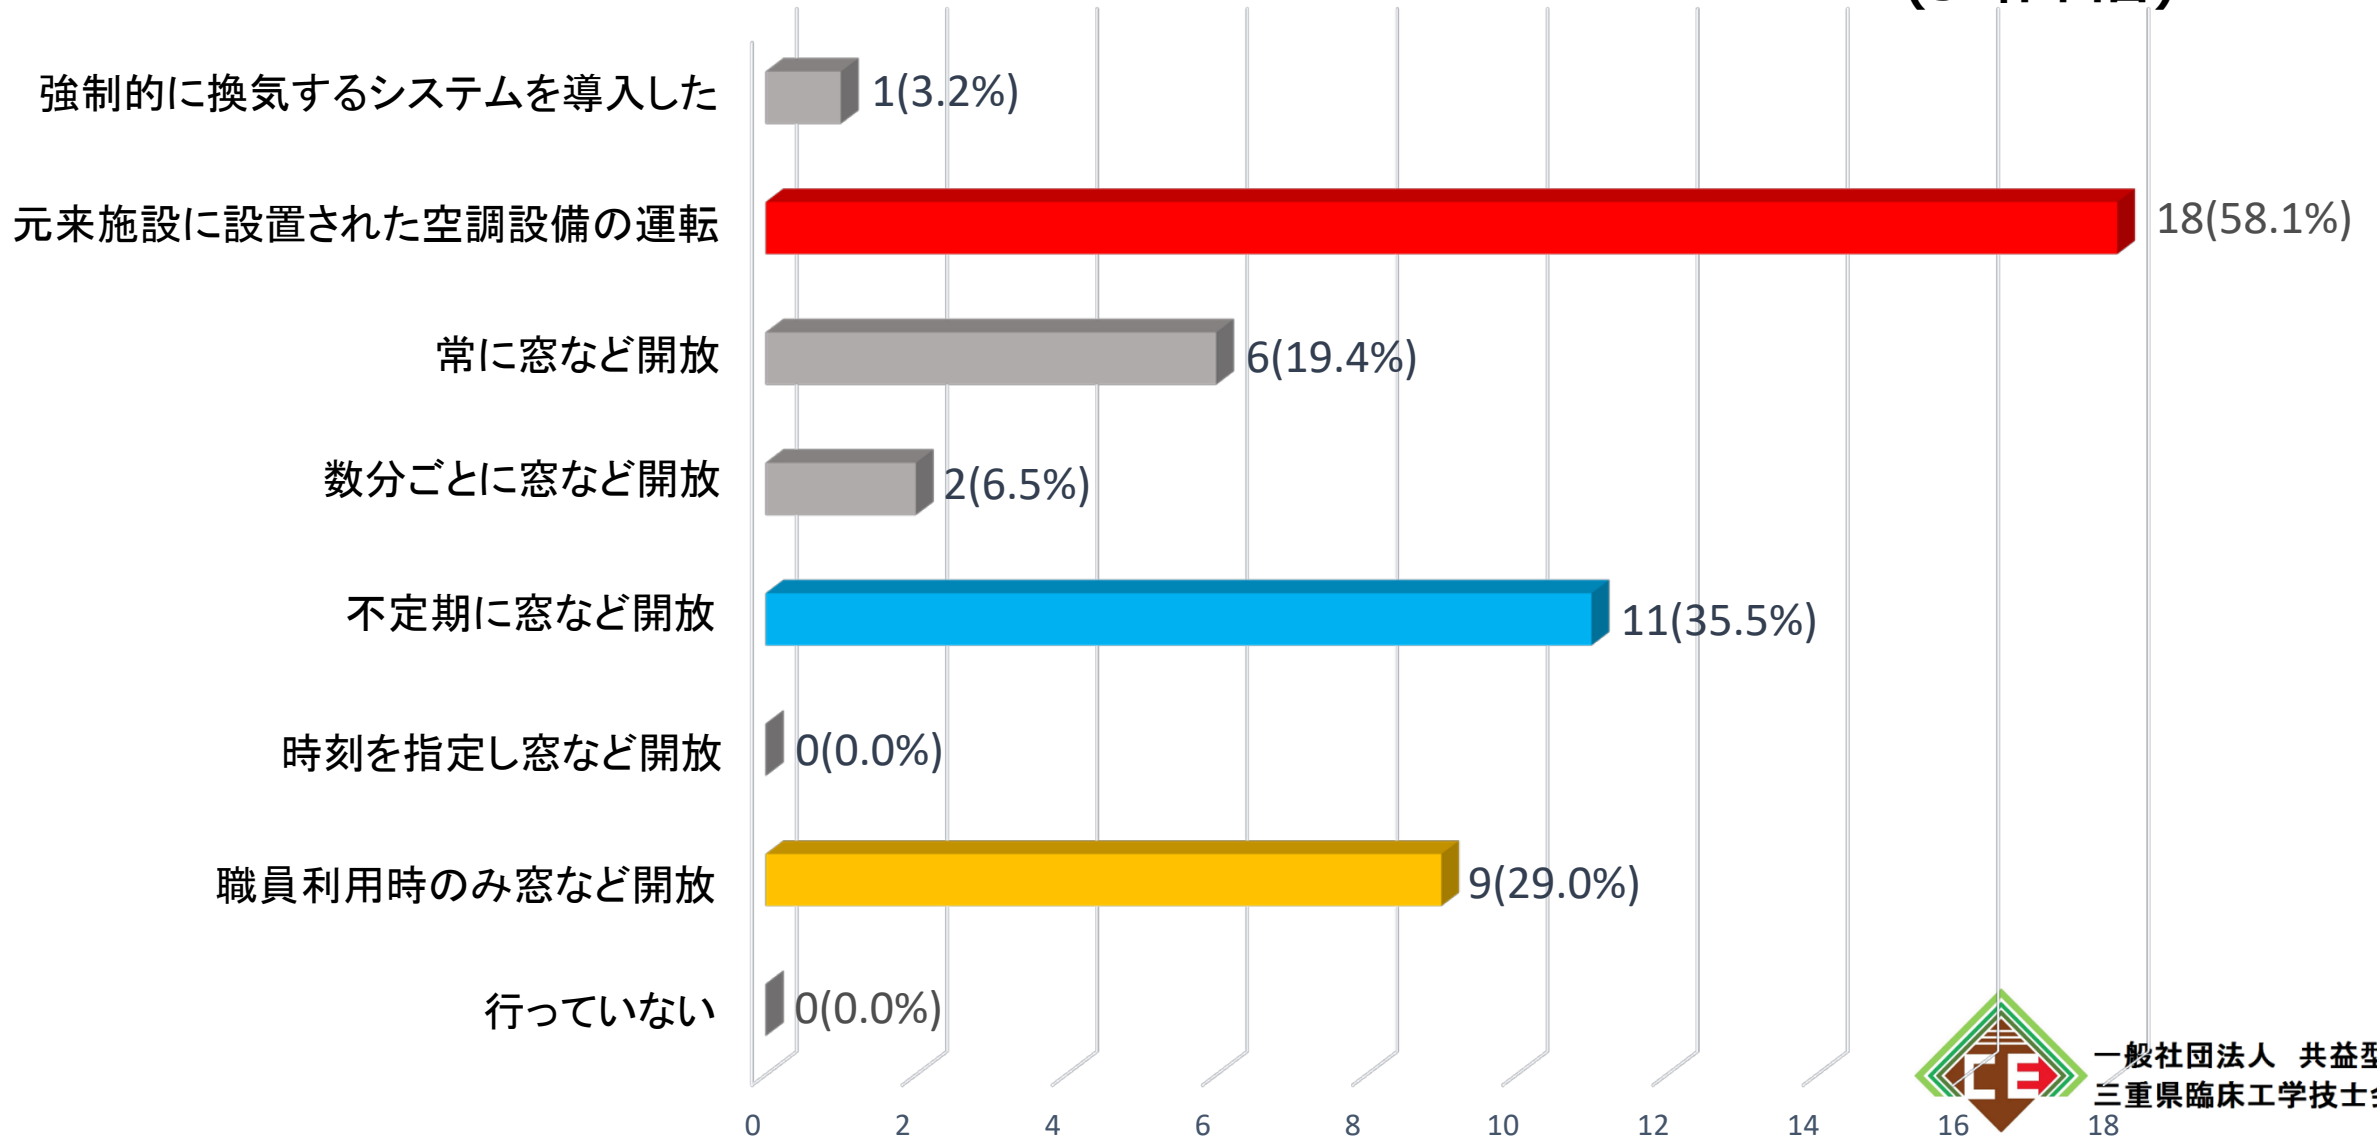


質問 2 4. 透析室以外で、職員が使用する設備で現在実施している
消毒場所と消毒薬等の分類で、該当するものをお答え
ください。複数回答可。

※質問25の回答も含む

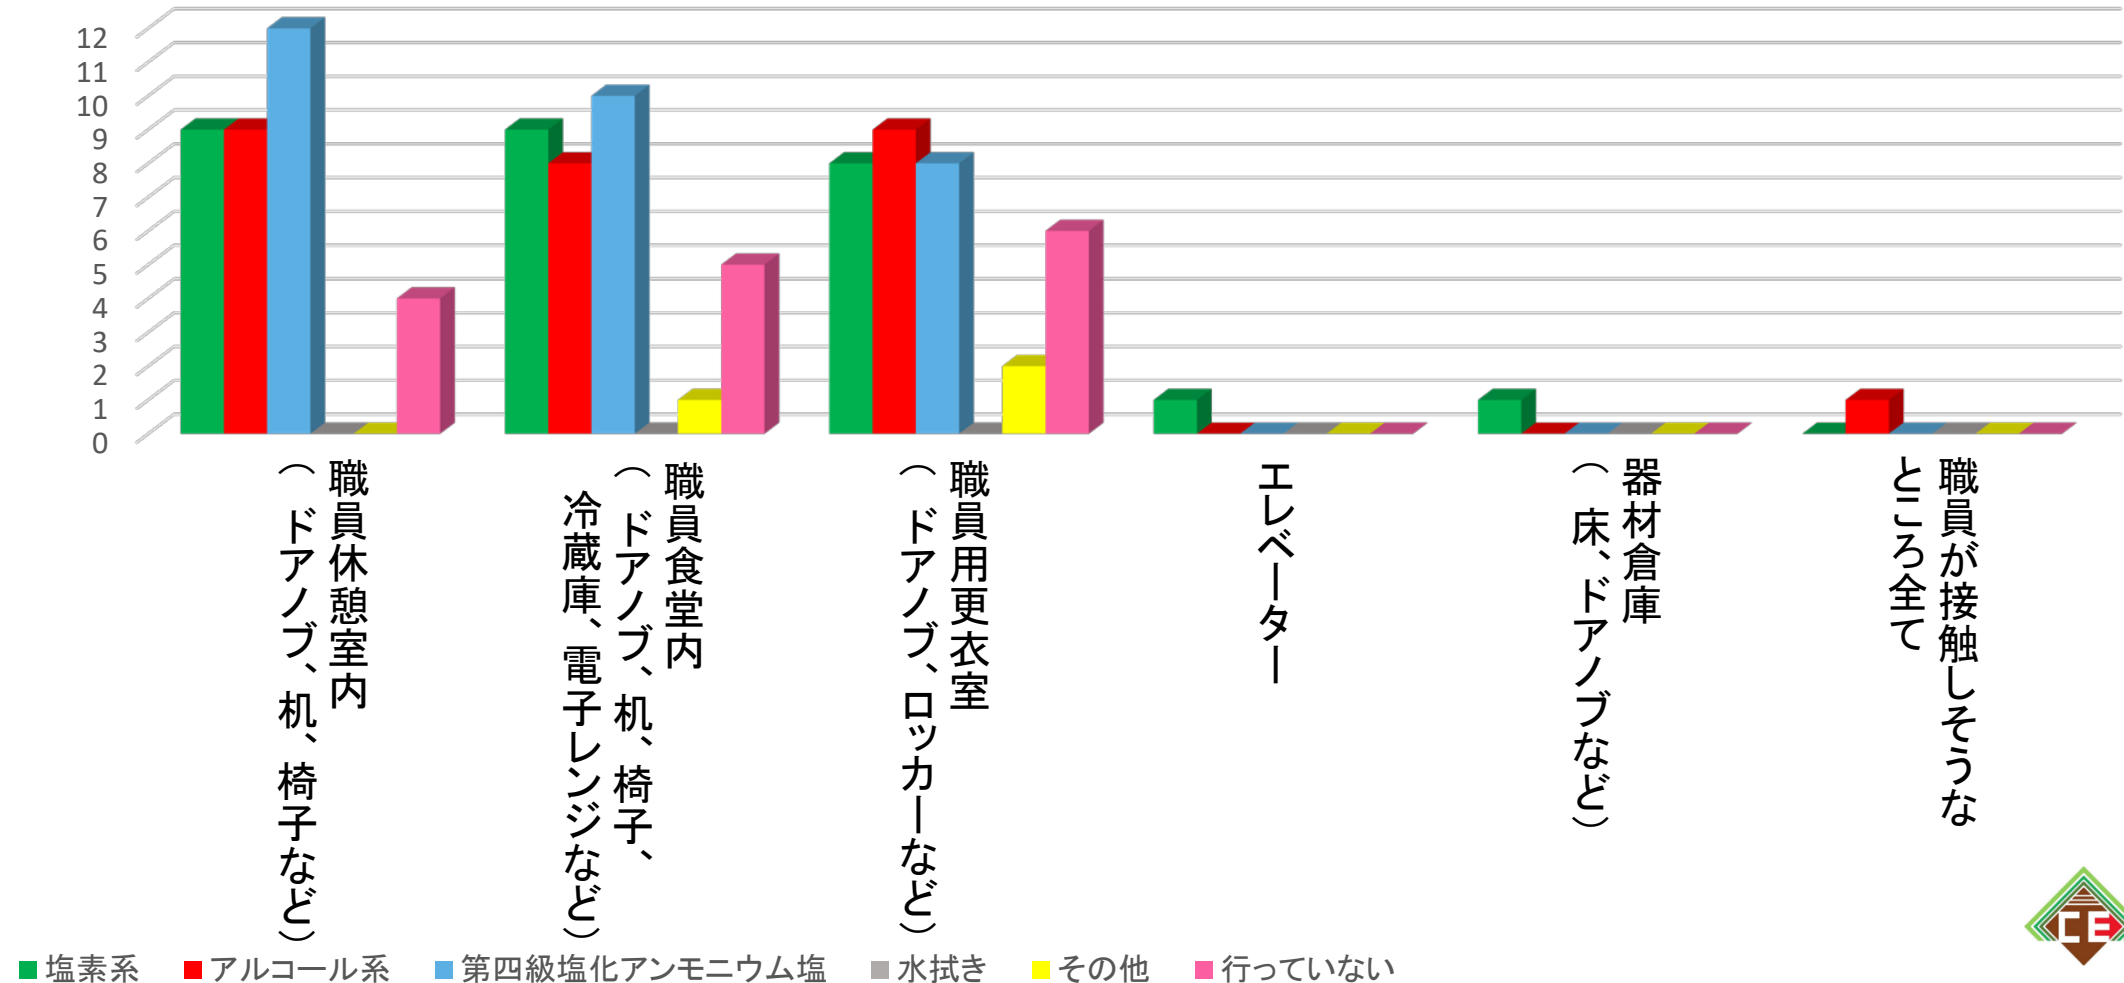

質問 2 6 . 所属施設でCOVID-19の透析患者が発生した場合
(疑いも含む)、または転入時の対応について、
該当するものをお答えください。


(31件 回答)

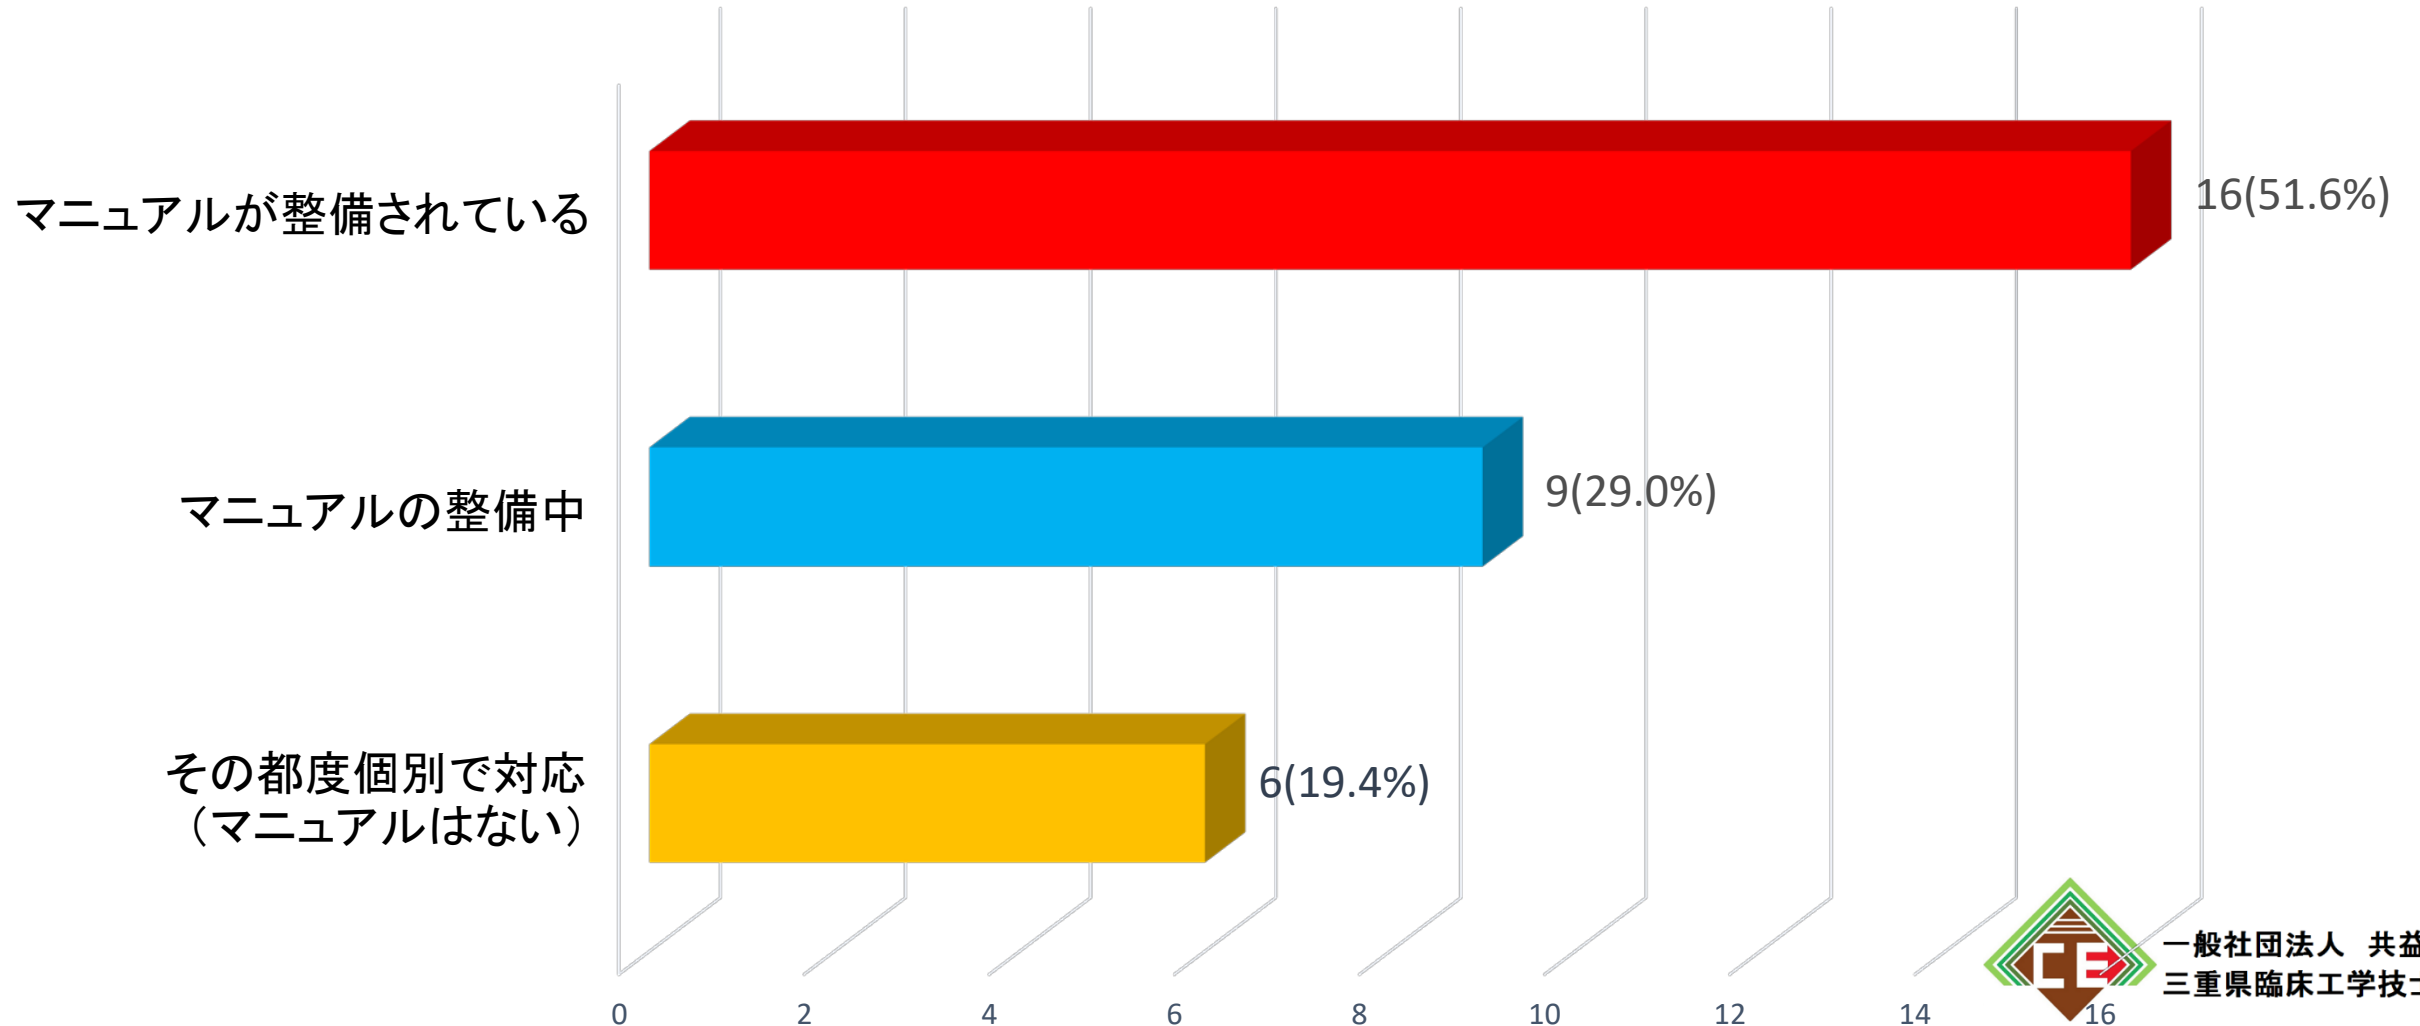

質問 27. マニュアルの有無に関わらず、施設で規定された項目として

以下に該当するものがあればお答えください。複数回答可。


(31件 回答)

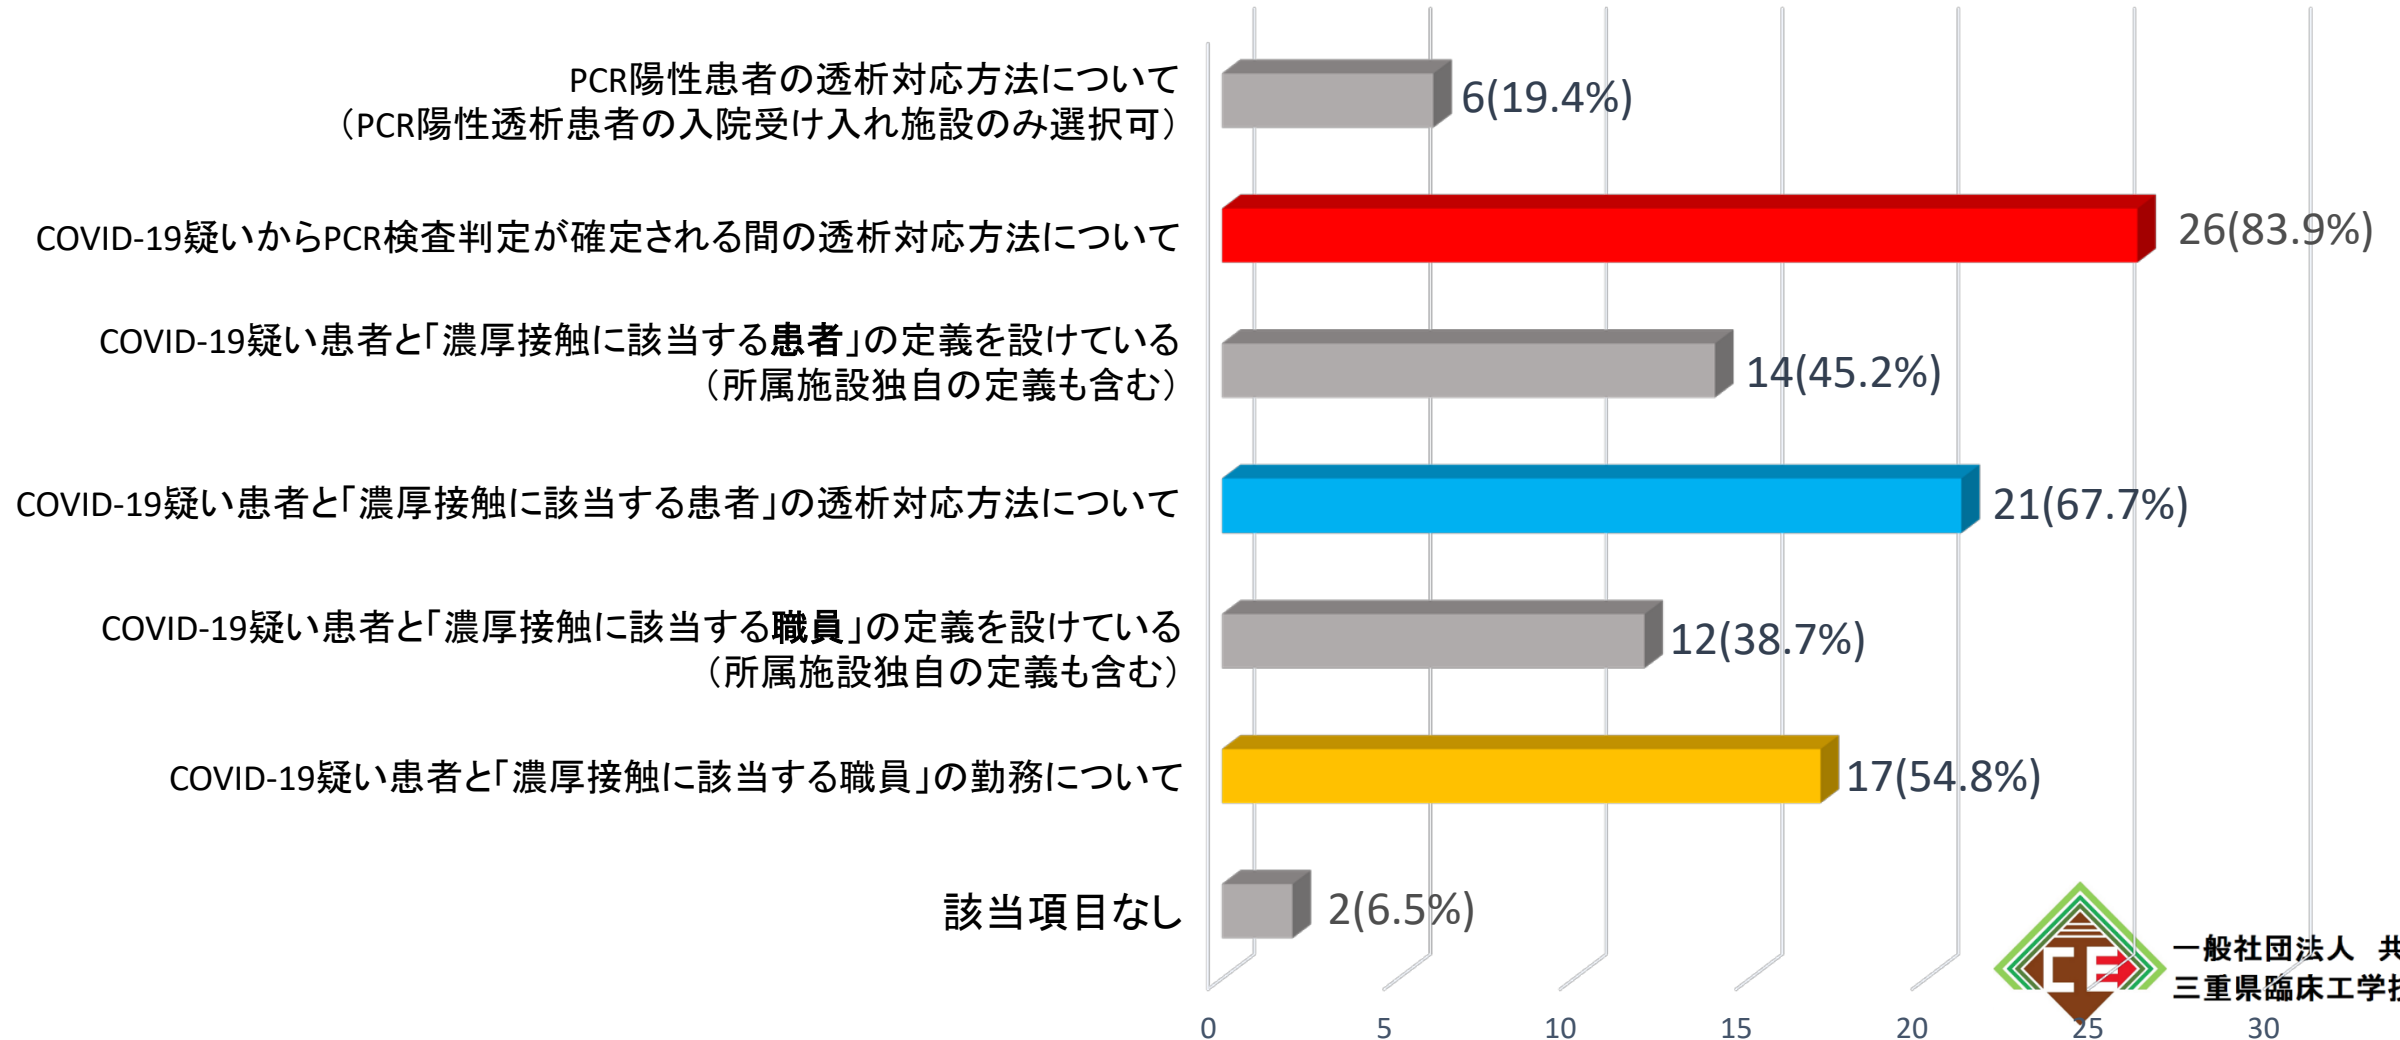

質問 2 8. 所属施設でCOVID-19の職員が発生した場合

(疑いも含む) の対応について、該当するものをお答え

ください。(当該職員の透析室勤務の有無は問いません)(31件 回答)

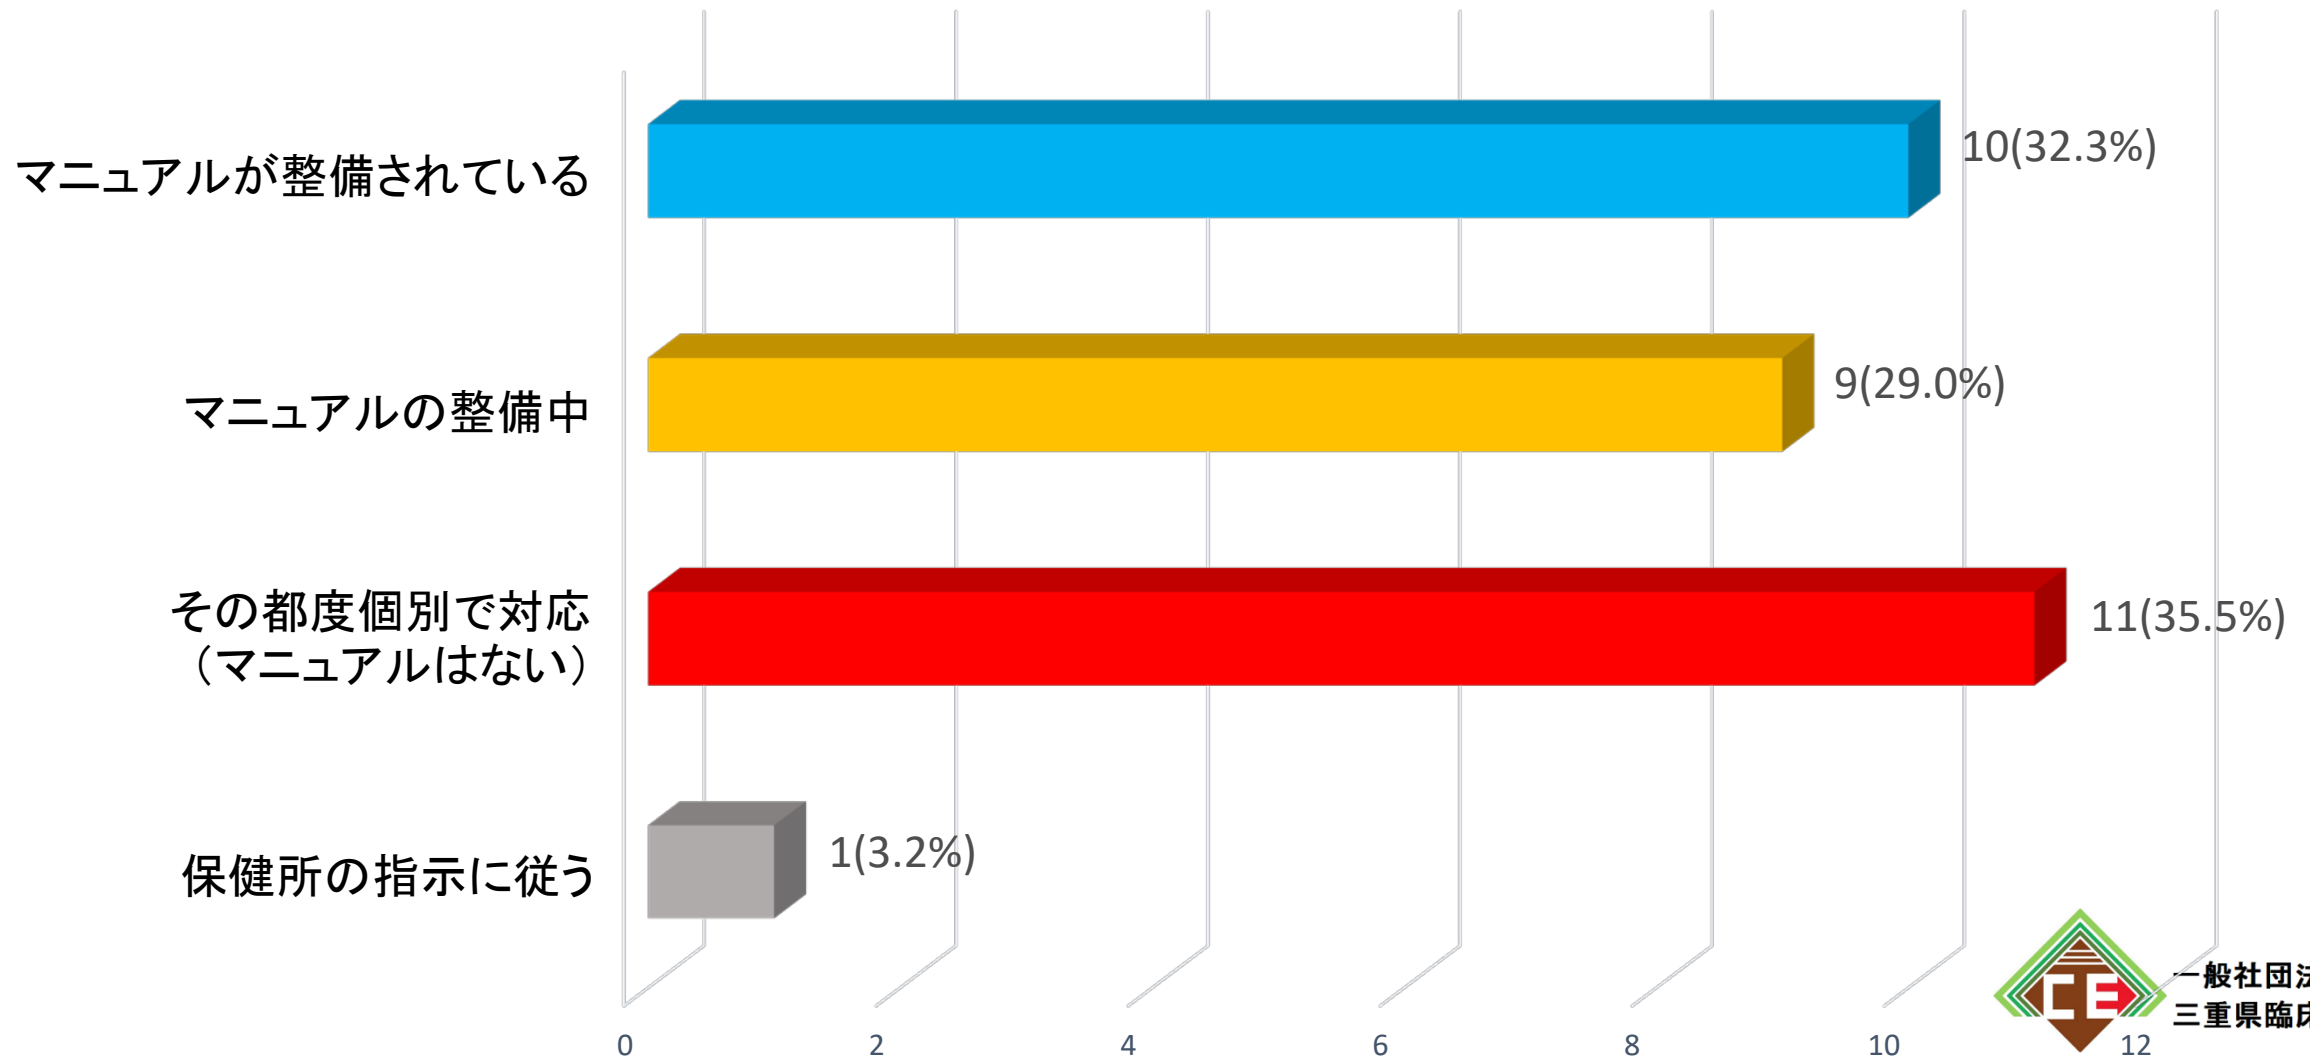

質問 29. マニュアルの有無に関わらず、施設で規定された項目として

以下に該当するものがあればお答えください。複数回答可。

(31件 回答)

